



INSTRUCCIONES DE USO

ÍNDICE

l.	Abrevi	iaturas	. 4
II.	Objeti	vo previsto	. 4
III.	Resun	nen y explicación	. 5
Ш	I.1 C	Operación	. 5
	III.1.1	Operación on-Premise	. 6
IV.	Princip	oio del procedimiento	. 7
V.	Glosa	rio de símbolos	. 8
VI.	Instruc	cciones de seguridad	. 9
V	'I.1 C	Cualificación del operador	. 9
٧	1.2	Copia de seguridad de datos	. 9
٧	′1.3 <i>A</i>	Advertencias y Precauciones	. 9
VII.	Instruc	cciones	10
V	'II.1 C	Configuración del software RAPTOR SERVER	10
	VII.1.1	Inicio de sesión	10
	VII.1.2	2 Ajustes personales	13
	VII.1.3	B Administración de inquilinos	13
	VII.1.4	Añadir usuario a un inquilino	17
	VII.1.5	Descarga del software del agente	20
	VII.1.6	S Actualización del software del agente	23
	VII.1.7	 Adquisición de imágenes, lectura de códigos QR y búsqueda de cuadrículas 24 	\$
	VII.1.8	Modo de procesamiento de imágenes2	28
	VII.1.9	Resumen de mediciones	37
	VII.1.1	O Aprobación y exportación de mediciones	40
V	/II.2 I	nforme4	45



VII.2	2.1	Creación de una plantilla de informe personalizada (plantilla 2025)	45
VII.2	2.2	Creación de una plantilla de informe personalizada (plantilla heredada)	48
VII.2	2.3	Solicitud de orientación interpretativa	61
VII.2	2.4	Múltiplex a la carta	66
VII.3	Ме	diciones de muestras de calidad	71
VII.4	Bor	rar mediciones	73
VII.5	Imp	ortar la información del paciente desde un archivo	75
VII.6	Aña 76	adir un usuario al portal de compartición de resultados y compartir una med	ición
VII.7	Cie	rre de sesión	77
VII.8	Por	tal de intercambio de resultados	78
VII.9	Asis	stencia técnica	80
VII.10	С	Oatos técnicos	80
VII.11	S	Solución de problemas	80
VIII Hist	orial	de cambios	84



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

MacroArray Diagnostics ha validado las instrucciones proporcionadas, los reactivos, el instrumento, el software y las funciones personalizables de este analizador para optimizar el rendimiento del producto y cumplir las especificaciones del mismo. MacroArray Diagnostics no admite modificaciones definidas por el usuario, ya que pueden afectar al rendimiento del analizador y a los resultados de las pruebas. Es responsabilidad del usuario validar cualquier modificación realizada en estas instrucciones, instrumentos, reactivos o software proporcionados por MacroArray Diagnostics.

Consulte las instrucciones de uso de las pruebas antes de procesarlas.

Los siguientes productos entran en el ámbito de aplicación del presente documento y se denominarán en lo sucesivo "pruebas" o "kits de pruebas":

Nombre del producto	Número REF	Marca CE	
ALEX ²	02-2001-01, REF 02-5001-01		
ALEX Air	06-5001-01	((
ALEX Food	07-5001-01	C € ₂₉₆₂	
ALEX ³	03-2001-01, REF 03-5001-01		
FOX	80-2001-01, REF 80-5001-01, REF 80-0001-01	((

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Se ha comprobado la exactitud de esta guía. Las instrucciones y descripciones del RAPTOR SERVER Analysis Software eran correctas en el momento en que se redactó esta guía. Las guías posteriores pueden modificarse sin previo aviso; no obstante, MacroArray Diagnostics no asume ninguna responsabilidad por daños causados directa o indirectamente por errores de la guía. ImageXplorer y RAPTOR SERVER son dispositivos de diagnóstico *in vitro* destinados a ser utilizados exclusivamente por personal de laboratorio cualificado.

Esta guía y el software descrito están protegidos por derechos de autor. Ninguna parte de esta guía o del software descrito puede ser duplicada, reproducida o copiada a un medio electrónico o formato legible por máquina sin el permiso previo por escrito de MacroArray Diagnostics.



I. ABREVIATURAS

Data Protection Agreement	Acuerdo de protección de datos
Guide dots	Puntos guía
Instructions for use	Instrucciones de uso
Immunoglobulin E	Inmunoglobulina E
Immunoglobulin G	Inmunoglobulina G
In-vitro diagnostics	Diagnóstico in vitro
Multiplex On Demand	Múltiplex a la carta
Quality control	Control de calidad
Research use only	Sólo para investigación
Terms of Service	Condiciones de uso
	Guide dots Instructions for use Immunoglobulin E Immunoglobulin G In-vitro diagnostics Multiplex On Demand Quality control Research use only

II. OBJETIVO PREVISTO

El RAPTOR SERVER Analysis Software controla e influye en los sistemas de procesamiento MADx en combinación con los productos basados en la tecnología ALEX. El software analiza la salida de los conjuntos basados en la tecnología ALEX y es utilizado por personal de laboratorio capacitado y profesionales médicos en un laboratorio médico.

Estas instrucciones de uso son aplicables al siguiente producto:

UDI-DI básico	REF	Producto	
91201229222JW	22-0000-01	RAPTOR SERVER Analysis Software	



III. RESUMEN Y EXPLICACIÓN

RAPTOR SERVER es una aplicación basada en la nube y se maneja a través del navegador (Google Chrome). RAPTOR SERVER es un software para la adquisición y el análisis de imágenes de dispositivos médicos tomadas por el ImageXplorer o un dispositivo MAX (MAX 45k y/o MAX 9k) a partir de matrices procesadas. RAPTOR SERVER realiza el almacenamiento de datos y la elaboración de informes basados en los resultados del laboratorio de diagnóstico.

El software consta de

- software de servidor basado en web que proporciona control de interfaz gráfica de usuario a través del navegador web del usuario. Este software de servidor se conoce comúnmente como RAPTOR SERVER.
- una aplicación independiente para la transmisión de datos entre el dispositivo ImageXplorer y el software del servidor. Esta aplicación se denomina comúnmente "AGENT".

El software se ha desarrollado específicamente para el análisis y la elaboración de informes de los resultados de los arrays.

Consulte el sitio web de MADx para obtener más información sobre las instrucciones de uso del kit de prueba, las características de rendimiento y el resumen de seguridad y rendimiento: https://www.madx.com/extras.

III.1 OPERACIÓN

Idealmente, la operación de RAPTOR SERVER debería estar centralizada, en forma de una aplicación SaaS (Software as a Service) basada en la nube. Sin embargo, también es posible un funcionamiento puramente local en un centro de datos propiedad del cliente (RAPTOR SERVER "on-premise"), aunque con un soporte y unas prestaciones mucho más limitados.

Para realizar un análisis con el RAPTOR SERVER se necesita una prueba y un dispositivo.

Para el análisis			
ALEX ²	REF 02-2001-01, REF 02-5001-01		
ALEX Air	REF 06-5001-01		
ALEX Food	REF 07-5001-01		
ALEX ³	REF 03-2001-01, REF 03-5001-01		
FOX – no certificado con organismo notificado	REF 80-2001-01, REF 80-5001-01, REF 80-0001-01		



Para imágenes/automatización		
ImageXplorer	REF 11-0000-01	
MAX 9k	REF 17-0000-01	
MAX 45k	REF 16-0000-01	

Para más información, consulte las IFU de los kits de prueba o dispositivos: https://www.madx.com/extras.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL USUARIO:

Para la correcta utilización del ImageXplorer y/o MAX Devices con el software RAPTOR SERVER, es necesario que el usuario lea detenidamente y siga estas instrucciones de uso. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por cualquier uso de este sistema de pruebas que no esté descrito en este documento o por modificaciones realizadas por el usuario del sistema de pruebas.

III.1.1 OPERACIÓN ON-PREMISE

Requisitos de hardware y software:

Gracias a los contenedores de aplicaciones proporcionados (imágenes Docker), RAPTOR SERVER puede ejecutarse en cualquier servidor Linux o Windows. El único requisito de software en el servidor, además del sistema operativo (proporcionado y mantenido por el cliente), es una instalación actualizada de Docker. Los contenedores de aplicaciones se instalan allí (mediante comandos Docker estándar), pueden iniciarse directamente e incluyen todas las demás dependencias en sus respectivos contenedores. Los requisitos concretos de hardware dependen del número de mediciones (datos) que se manejen en la instalación de RAPTOR SERVER, pero normalmente los servidores estándar para pequeñas empresas son más que suficientes (2 núcleos de CPU, 16 GB de memoria, 100 GB de espacio en disco). Una vez iniciados los contenedores de la aplicación, RAPTOR SERVER puede utilizarse directamente a través del navegador del servidor o, si el cliente lo desea, puede conectar el servidor a la red local para que RAPTOR SERVER esté disponible en otros ordenadores conectados al servidor (de nuevo, a través del navegador).

Como la variante local utiliza los mismos contenedores de aplicaciones que la variante basada en la nube, se dispone de las mismas protecciones contra el acceso no autorizado al software (nombre de usuario, contraseña segura, MFA, etc.). El acceso no autorizado al propio hardware del servidor y al sistema operativo es responsabilidad del cliente y de los administradores del sistema allí presentes. Una medida principal contra el acceso no autorizado en escenarios on-premise es la desconexión de Internet (sólo acceso desde el servidor local o la red).



Proceso de instalación y actualización para instalaciones locales:

Todos los contenedores de aplicaciones (imágenes Docker) están disponibles en un Registro Docker público proporcionado por MADx. Tanto la instalación basada en la nube como las instalaciones locales pueden descargar la última versión validada de los contenedores de aplicaciones utilizando la funcionalidad y los comandos estándar de Docker. El acceso al Registro de Contenedores es posible desde Internet, pero está protegido por contraseña. Tan pronto como una nueva versión (ya sea una nueva versión planificada, o una versión hotfix) es validada y liberada por MADx, está disponible en este Registro Docker. A continuación, se despliega automáticamente en la instalación basada en la nube. Los clientes locales son informados de las nuevas versiones por correo electrónico o a través de sus distribuidores.

IV. PRINCIPIO DEL PROCEDIMIENTO

Las pruebas son inmunoensayos en fase sólida. Los extractos de alérgenos / antígenos o los alérgenos / antígenos moleculares, que están acoplados a nanopartículas, se depositan de forma sistemática sobre una fase sólida formando un conjunto macroscópico.

En primer lugar, los alérgenos unidos a partículas reaccionan con anticuerpos específicos presentes en la muestra del paciente. Tras la incubación, se lavan las uniones no específicas. El procedimiento continúa añadiendo un anticuerpo de detección antihumano marcado con enzimas que forma un complejo con los anticuerpos específicos unidos a la partícula. Tras un segundo lavado, se añade el sustrato, que la enzima unida al anticuerpo convierte en un precipitado insoluble coloreado. Por último, se detiene la reacción enzima-sustrato añadiendo un reactivo de bloqueo. La cantidad de precipitado es proporcional a la concentración de anticuerpos específicos en la muestra del paciente.

El procedimiento de prueba de laboratorio va seguido de la adquisición y el análisis de imágenes mediante un dispositivo ImageXplorer o MAX. Los resultados de la prueba se analizan con el RAPTOR SERVER de MADx. Los resultados de la prueba se informan en unidades IgE específicas de alérgenos (kU_A/I), junto con los resultados IgE totales en unidades IgE (kU/I)), o unidades de IgG (μg/ml) dependiendo de la prueba utilizada. Las unidades cuantitativas (kU_A/I) se calculan a partir de unidades de intensidad arbitrarias mediante regresión lineal. Los parámetros de la curva para la transformación matemática se derivan de la prueba y los proporciona el software de análisis RAPTOR SERVER.



V. GLOSARIO DE SÍMBOLOS

IVD	Productos sanitarios para diagnóstico in vitro		
CE	CE mark		
C E 2962	Marca CE (Notified Body 2962: QMD Services GmbH, Zelinkagasse 10/3, 1010 Vienna, Austria		
	Fabricante		
<u> </u>	Precaución		
MAD MACRO ARRAY DIAGNOSTICS	MacroArray Diagnostics (MADx)		



VI. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el producto se comunicará al MADx y a la Autoridad Competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o el paciente.

VI.1 CUALIFICACIÓN DEL OPERADOR

El RAPTOR SERVER Analysis Software debe ser operado por o bajo la supervisión de un técnico u operador suficientemente cualificado para el trabajo de laboratorio. Antes de operar el RAPTOR SERVER Analysis Software el operador debe:

- Lea atentamente estas instrucciones de uso
- Conocer todos los procedimientos de laboratorio pertinentes
- Conocer todas las normas y reglamentos de seguridad pertinentes

VI.2 COPIA DE SEGURIDAD DE DATOS

Cuando se utiliza RAPTOR SERVER, todos los datos analíticos y relacionados con el paciente se almacenan de acuerdo con el MADx Terms of Service Agreement en el Microsoft Azure Online Portal. Consulte también los Términos de servicios en línea (OST) de Microsoft, disponibles en https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products. Para la versión RAPTOR SERVER on-premise, consulte con su administrador de TI local.

VI.3 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Los resultados y los datos deben ser aprobados manualmente por una persona cualificada.
 RAPTOR SERVER Analysis Software sugiere ajustes óptimos (por ejemplo, ajustes de cuadrícula), que requieren revisión y optimización manual si es necesario.
- La aprobación de este informe no constituye automáticamente un diagnóstico. Este informe debe ser considerado junto con otros hallazgos clínicos e interpretado por un alergólogo o médico. Consulte siempre a un profesional sanitario cualificado para obtener un diagnóstico preciso y recomendaciones de tratamiento.
- RAPTOR SERVER Analysis Software incluida la API, ha sido totalmente validado por MADx. La interacción entre cualquier software externo y la API, así como el propio software externo, no están cubiertos por la validación realizada por MADx.
- Deben seguirse las medidas estándar de protección de datos, integridad de datos y seguridad de datos. Estas incluyen, pero no se limitan a:
- el uso de contraseñas fuertes y únicas,
- el uso de autenticación multifactor,
- restringir el acceso al software y a los datos únicamente al personal autorizado,
- no compartir información sensible (por ejemplo, clave API, contraseñas, etc.).



VII. INSTRUCCIONES VII.1 CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE RAPTOR SERVER

Se recomienda Google Chrome como navegador para utilizar el RAPTOR SERVER. Se puede acceder a la interfaz gráfica de usuario de RAPTOR SERVER en el sitio web: https://www.raptor-server.com

La instancia de RAPTOR SERVER está diseñada para el funcionamiento SaaS y, por lo tanto, admite varios inquilinos independientes. Cada inquilino está lógicamente diferenciado de todos los demás inquilinos y no es posible de ninguna manera el intercambio de datos entre inquilinos.


VII.1.1 INICIO DE SESIÓN


Un Tenant es la entidad en línea para un único laboratorio dentro del RAPTOR SERVER. Los Tenants son creados por MADx, y el acceso es proporcionado por su distribuidor local.

Varios usuarios pueden iniciar sesión en una plataforma Tenant. El acceso a un Tenant en RAPTOR SERVER solo estará disponible para usuarios con un nombre de usuario y una contraseña válidos especificados por MADx o por un servicio de directorio externo (Office 365/Azure Active Directory). Las cuentas de usuario son creadas por el administrador del Tenant (distribuidor local, o MADx). En caso de que se hayan olvidado los datos de inicio de sesión, la contraseña también se puede restablecer en la pantalla de inicio de sesión.




Welcome to RAPTOR SERVER Analysis Software, the analysis software for the ALEX multiplex test. Please log in below to continue.








Haciendo clic en el icono del ojo se puede hacer visible la contraseña introducida.

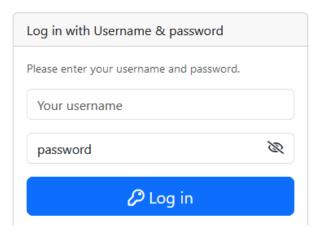


Después de iniciar sesión con éxito, el usuario tiene que confirmar la lectura y aceptación de cada documento para acceder a la funcionalidad completa del software por primera vez. Este es también el caso si hay nuevas instrucciones de uso, términos de servicios u otros acuerdos disponibles, el usuario será informado por la misma nueva ventana emergente justo después de iniciar sesión en el Software de Análisis RAPTOR SERVER y tiene que confirmarlos.

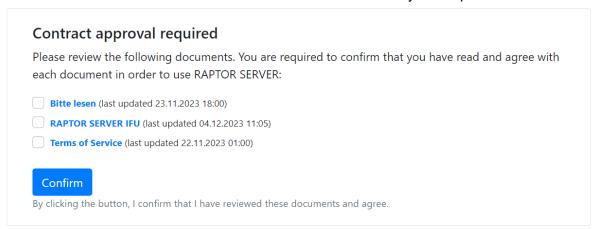


Después de confirmar y obtener acceso a su inquilino, uno tiene una vista del salpicadero. En la parte izquierda de la pantalla, el usuario ve las últimas mediciones nuevas y aprobadas.



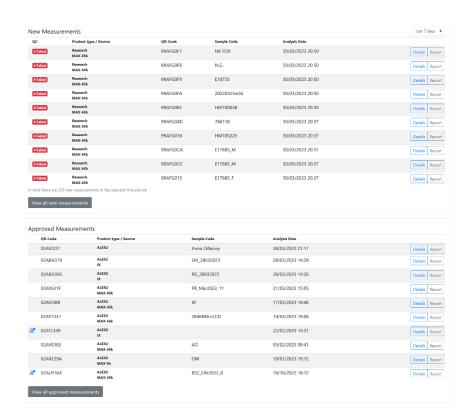

En la parte derecha de la pantalla se muestran los dispositivos conectados y la fecha de su último escaneado de ConfigXplorer y/o mantenimiento mensual (sólo para dispositivos MAX). Además, las mediciones periódicas, así como las exploraciones de ConfigXplorer r y el mantenimiento mensual se pueden iniciar a través del panel de control. Además, los enlaces a la configuración general de los dispositivos mostrados ("Configure") y a las grabaciones de las mediciones de control de calidad ("QC History") también se pueden encontrar en el panel.

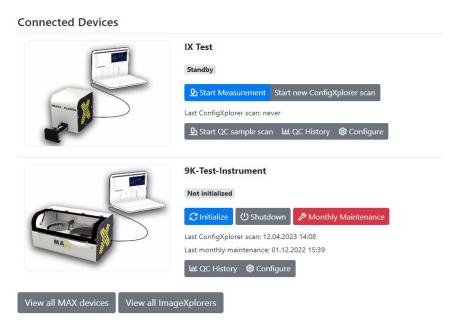




VII.1.2 AJUSTES PERSONALES


En "Personal Settings" puede seleccionar el idioma del usuario, la cultura (por ejemplo, inglés (UK)) y la zona horaria. Para hacer visibles los puntos RUO, el usuario puede seleccionar "show research spots" en el menú desplegable. Además, se puede seleccionar el idioma de visualización, una vez que la traducción esté disponible.

RAPTOR SERVER soporta Autenticación de Factores Múltiples (MFA) de usuarios con nombre de usuario y contraseña dados. Se puede configurar en los ajustes personales, utilizando una aplicación de autenticación (Google o Microsoft) instalada en el smartphone del usuario. Haciendo clic en Gestionar MFA en la página de Configuración Personal, el usuario será guiado para configurar la MFA.

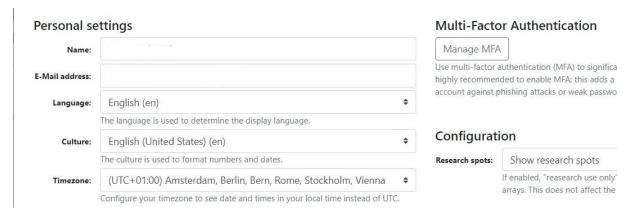

VII.1.3 ADMINISTRACIÓN DE INQUILINOS


Si hace clic en el icono de menú situado en la esquina superior derecha y selecciona Tenant Admin, accederá al área Tenant Admin, donde podrá establecer las preferencias de su inquilino.





En primer lugar, acceda a la página de Configuración de inquilinos y rellene los datos de la empresa como corresponda. Asegúrese de que los detalles de la empresa representan datos oficiales. Los administradores con el derecho de acceso «Can manage basic tenant configuration» pueden aplicar la autenticación multifactor (MFA) a todos los usuarios de un inquilino. Una vez activada la aplicación de la MFA, se pedirá a los usuarios que completen la configuración de la MFA durante su próximo inicio de sesión.



Configure "MADx"

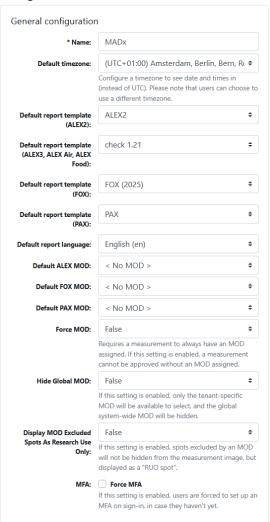

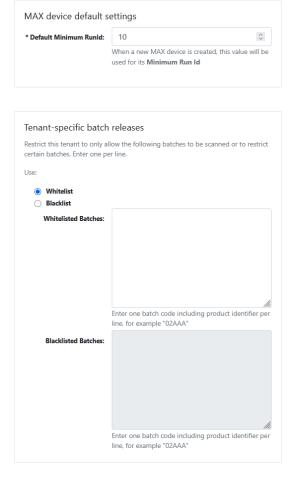


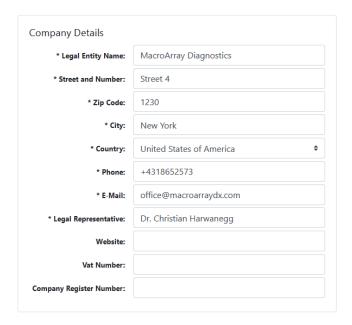



VII.1.3.1 CREACIÓN DE LISTAS NEGRAS Y BLANCAS DE LOTES

Un usuario que tenga el derecho de acceso "Can manage basic tenant configuration" puede incluir lotes individuales en una lista negra o blanca por inquilino. Para poner un lote en la lista negra o en la lista blanca, basta con seleccionar "Lista blanca" ("Whitelist") o "Lista negra" ("Blacklist") e introducir el código o códigos del lote que desea poner en la lista negra o en la lista blanca.

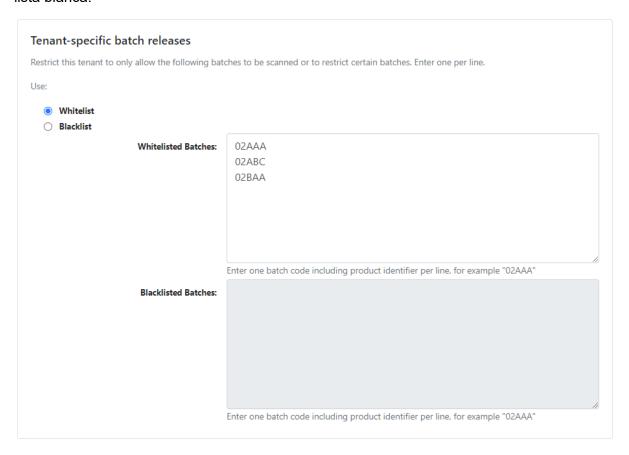

Si un lote está en la lista negra, ya no podrá ser escaneado y el RAPTOR SERVER devolverá un error.

You requested a new measurement from ImageXplorer "IX Trainingsraum". Please wait until the measurement is completed ...

Invalid batch detected! The measurement can't be processed because its batch is blocked.

Si un lote está en la lista blanca, RAPTOR SERVER sólo permitirá escanear lotes con este código.




Otras páginas importantes del área Tenant Admin son:

- ImageXplorers y MAX Devices: Utilice esta opción para configurar los ImageXplorers / MAX Devices existentes o añadir otros nuevos. Cada ImageXplorer / MAX Devices necesita ser registrado como una entidad al Tenant en RAPTOR SERVER, de lo contrario una conexión no es posible.
- Plantillas de informes: Utilice esta opción para crear, editar o eliminar plantillas de informes para este inquilino. Cada plantilla puede tener su aspecto y configuración específicos.
- Cumplimentación de datos de medición: Gestione la información predefinida del paciente que puede asignarse a una medición.
- Portal de Compartición de Resultados: Utilice esta opción para crear, editar o eliminar usuarios en el Portal de intercambio de resultados para este arrendatario. Las mediciones pueden compartirse con usuarios del Portal de resultados compartidos, y los usuarios pueden utilizar el Portal de resultados compartidos para acceder a esas mediciones.



VII.1.4 AÑADIR USUARIO A UN INQUILINO

En el área de administración de inquilinos, también puede crear y editar usuarios para cada inquilino. Para ello, haga clic en "Manage Users".




A continuación, se muestra una lista de todos los usuarios del arrendatario actual. A través de "Configure", se pueden ajustar los derechos de un usuario existente. El botón "Add new user" en la parte superior de la página añade un nuevo usuario a la tenant. Los usuarios ya existentes (de otro tenant) pueden vincularse a los usuarios mediante la opción "Add user from another tenant".

Add new user

Tras hacer clic en "Add new user", se pueden añadir el nombre, la dirección de correo electrónico y la información de inicio de sesión del nuevo usuario. Un usuario puede autenticarse mediante nombre de usuario y contraseña, o mediante una cuenta Microsoft definida por la información del campo "Azure AD UPN".

A través de los grupos de usuarios predefinidos (por ejemplo: personal de laboratorio, apoyo, etc.), los derechos del usuario pueden asignarse a un grupo específico. Además, los derechos también pueden ajustarse individualmente para cada usuario.

Add New User

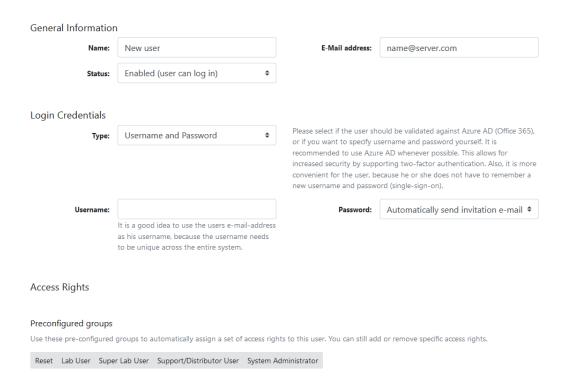



También se puede añadir un usuario a varios arrendatarios en un solo paso (edición masiva) utilizando la función situada en la parte inferior de la página. El usuario debe hacer clic en la casilla "Add User to all tenants shown below".

Q	Start typing a tenant name
	Add user to all tenants shown below
	MADx
	MadX_Training
	New Tenant

Puede asignar el usuario en cuestión sólo a los arrendatarios en los que ya está presente. En la parte inferior de la página, verá la lista de arrendatarios a los que ya está asignado este usuario, con los derechos de usuario correspondientes, y debajo una lista desplegable de arrendatarios adicionales a los que se puede asignar este usuario.



Para asignar el usuario a un inquilino adicional, marque las casillas de los inquilinos (también puede utilizar la barra de búsqueda para buscar uno), donde desee añadir el usuario que configure y haga clic en guardar. Los derechos sobre el inquilino actualmente abierto se aplicarán automáticamente al usuario. Tras hacer clic en "Save" al final de la página, el usuario recibirá un correo electrónico de bienvenida. A través de este correo electrónico, el usuario ya puede iniciar sesión en el RAPTOR SERVER.




Additionally this user can be added to the following tenants by checking the tenant name and hitting save afterwards. User right applied from current open tenant user.



Puede editar los derechos de usuario de forma masiva, correspondientes a varios arrendatarios a la vez, utilizando la vista general tabular de arrendatarios/derechos de usuario. Seleccione las casillas de los arrendatarios para los que desea establecer los derechos de este usuario en particular. Tras la selección, aparecerá un botón en la parte superior para editar los derechos de todos los arrendatarios seleccionados. Al hacer clic en el botón, accederás a la página habitual de edición de derechos de usuario. Los ajustes que hagas afectarán a todos los inquilinos que hayas seleccionado antes.

Tenants

This user is connected to the following tenants and has the following access rights:

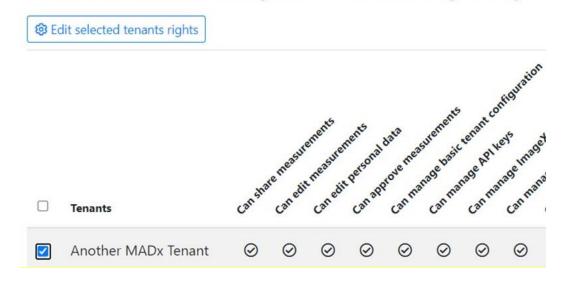


Tras hacer clic en "Save" al final de la página, el usuario recibe un correo electrónico de bienvenida. A través de este correo electrónico, el usuario puede iniciar sesión en el RAPTOR SERVER.



VII.1.5 DESCARGA DEL SOFTWARE DEL AGENTE

Para configurar un dispositivo (en este ejemplo, un ImageXplorer) para su inquilino, vaya al área de administración del inquilino y haga clic en "Manage ImageXplorers". Para añadir un nuevo ImageXplorer, selecciona "Add new ImageXplorer" y asígnale un nombre. Se generará automáticamente una clave ImageXplorer.

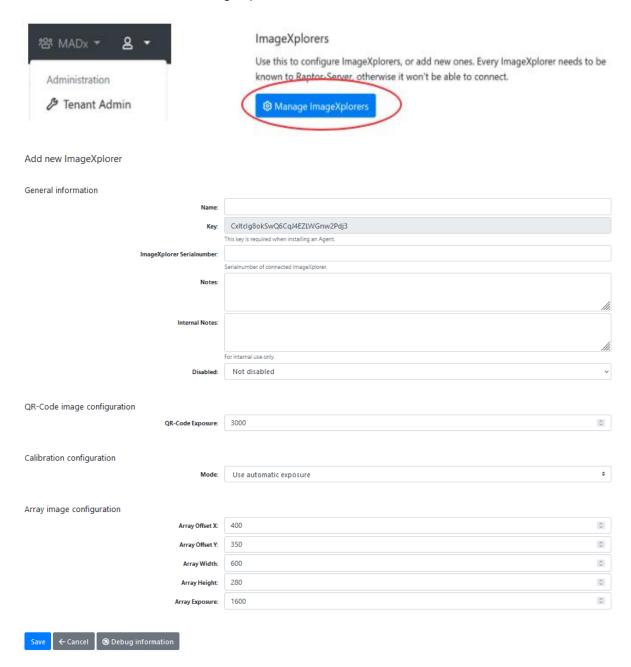

Después de hacer clic en "Save" volverá a la página de resumen del ImageXplorer correspondiente. Aquí podrá descargar el software ImageXplorer Agent.






Realice la instalación del agente ImageXplorer, como un proceso de instalación normal.


NOTA: El uso del ImageXplorer requiere la presencia del software "Pylon Runtime 6.1.1, de Basler. Si instala la versión "completa" del Agente ImageXplorer, el software está incluido. Si ya dispone de este software, basta con instalar la versión "slim" del Software.

NOTA: Se sugiere eliminar cualquier otro software de Pylon del PC antes de instalar el Agente ImageXplorer, como las versiones anteriores de Pylon Runtime.

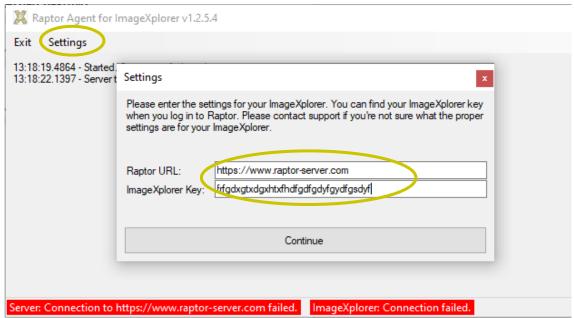

Para activar el Agente y conectarlo a ImageXplorer y RAPTOR SERVER, por favor vaya a Configuración y escriba la URL de RAPTOR SERVER: https://www.raptor-server.com y su Clave de ImageXplorer y haga clic en "Continuar".



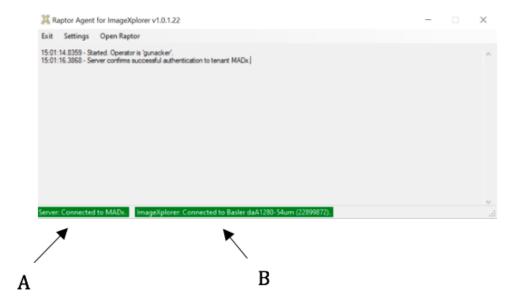

A: Conexión al RAPTOR SERVER

B: Conexión a ImageXplorer

Si se establece una conexión tanto con el RAPTOR SERVER como con el ImageXplorer, ambos campos se resaltan en verde. Si falla una conexión, consulte la sección de solución de problemas para obtener más instrucciones.


Para más información sobre cómo ajustar la configuración de un dispositivo, consulte las instrucciones de uso de ImageXplorer o del dispositivo MAX, respectivamente.



VII.1.6 ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DEL AGENTE

Una vez lanzada la actualización, el usuario recibe un aviso emergente en la ventana de su software de Agente. Haga clic en Aceptar y, a continuación, en "Ja" para llevar a cabo la actualización.

NOTA: Es posible que necesite derechos de administrador en el PC para instalar el software.

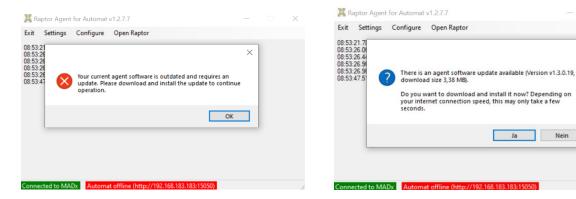


Si ha omitido la ventana emergente, puede iniciar la actualización en cualquier momento haciendo clic en "Instalar actualización".



Es posible que Windows le interrumpa y le pregunte si "you would like to allow the software to

make changes".




Diga "<u>Yes</u>" para continuar. A continuación, se procederá a una instalación de software similar a la de otro software común (asistente de instalación de Windows). Una vez completada la actualización, el agente se reiniciará.



VII.1.7 ADQUISICIÓN DE IMÁGENES, LECTURA DE CÓDIGOS QR Y BÚSQUEDA DE CUADRÍCULAS


En la página de vista general encontrará una pestaña "New Measurements", una pestaña "Approved Measurements", un botón para "Start measuremt with ImageXplorer" y un botón para dispositivos MAX. La pestaña "New Measurements" contiene todas las mediciones nuevas y no aprobadas, la pestaña "Approved Measurements" contiene todas las mediciones aprobadas hasta ahora.



El código QR de cada cartucho contiene la siguiente información:

- tipo de matriz de prueba (ALEX²)
- disposición de los alérgenos correspondientes
- Información de control de calidad
- Número de lote del cartucho

Tras la obtención de imágenes y el análisis, se muestra un resumen detallado de la medición con los campos de información del paciente y de la muestra a la izquierda, una imagen analítica de la matriz a la derecha y una vista detallada de los resultados de los alérgenos debajo.

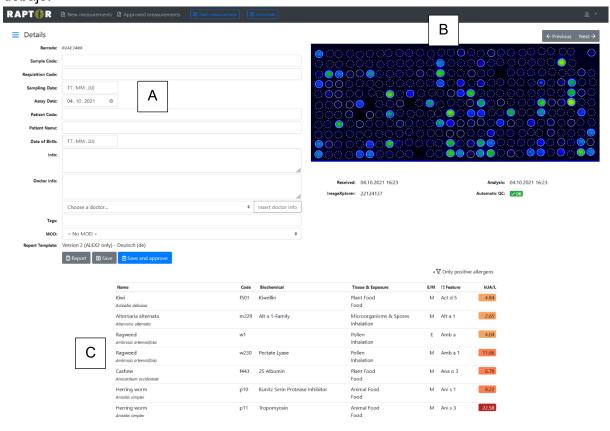



A: Campos de información sobre el paciente y la muestra

B: Imagen analítica

C: Vista de resultados


Además, debajo de la imagen analizada se muestra la fecha del análisis, el número de serie del ImageXplorer, el control de calidad y posiblemente también un registro de errores. Se puede añadir manualmente información adicional sobre la muestra y el paciente:

- Sample Code (código de muestra)
- Requisition coed (código de solicitud)
- Sampling date (fecha de muestreo)
- Assay date (fecha de ensayo)
- Patient code (código de paciente)
- Name of the patient (nombre del paciente)
- Date of birth (fecha de nacimiento)
- Additional information (información adicional (Info))
- Name of the referring physician (nombre del médico remitente (Doctor Info))
- Tags (etiquetas)
- MOD panel (Panel MOD)

Las entradas de "Info" e "Doctor Info" pueden formatearse para que aparezcan en negrita, en cursiva y/o subrayadas. Esto se hace de la siguiente manera:

- Info_ aparecerá <u>subrayado</u>
- *Info* aparecerá en cursiva
- **La información** aparecerá en negrita



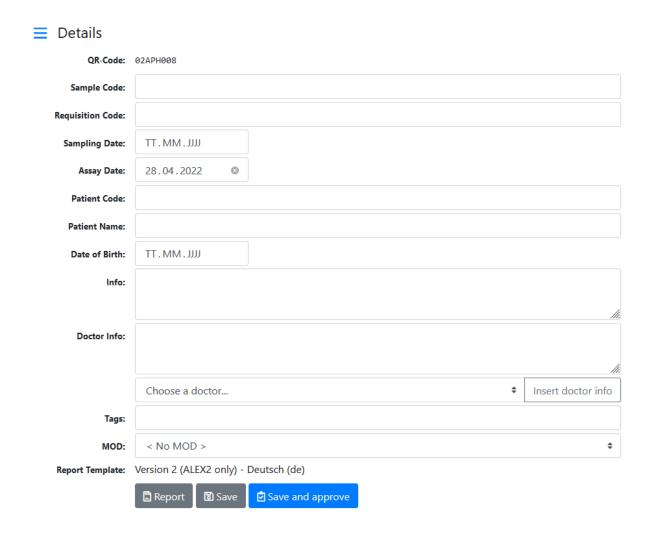

Si hace clic en "Save", se guardará la información introducida.

El array de la medición con cuadrícula se muestra en el área de imagen analítica. El software identifica automáticamente la posición del array en los datos de la imagen basándose en los puntos guía. Para más información sobre los puntos guía, consulte las instrucciones de uso específicas del producto.

Después del procesado, los puntos guía deben ser fácilmente visibles a simple vista. . Compruebe también su orientación correcta. Si no son visibles, por favor contacte con su distribuidor local o con el soporte de MADX para saber cómo proceder. En caso de que los Guide Dots sean visibles, el cartucho puede ser analizado más a fondo.

Durante la adquisición de imágenes de un cartucho, el RAPTOR SERVER evalúa la señal de todos los Guide Dots así como la señal de fondo de la superficie de la membrana. Si se cumplen todos los criterios de calidad, el campo "automatic QC" debajo de la imagen se pone en "OK".





Con el fin de excluir la influencia de artefactos en el análisis automatizado de imágenes (manchas de satélite, contaminaciones de muestras, polvo, manchas manchadas, ...), las imágenes deben ser revisadas por un operador entrenado antes de que los resultados sean aprobados con el fin de excluir resultados falsos. En caso de discrepancias entre el array procesado y la imagen adquirida por el RAPTOR SERVER, por favor consulte a su distribuidor local o al Soporte MADX.



VII.1.8 MODO DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES


Para entrar en el modo de tratamiento de imágenes, haga clic en la imagen.

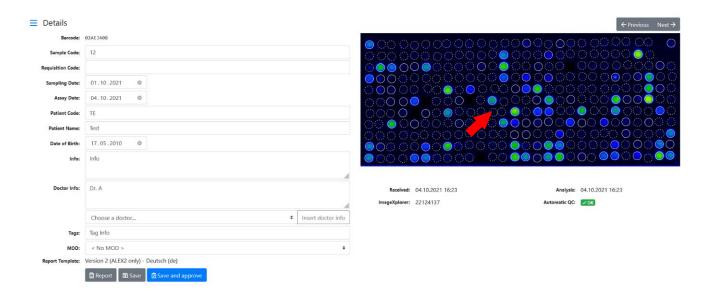


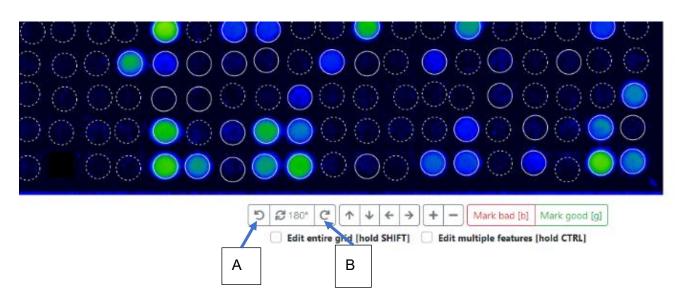

Si la búsqueda automática de la posición falla, el usuario será alertado y el control de calidad (QC) de la medición se establecerá en FAIL. En este caso, el usuario puede intentar posicionar manualmente el array reseteando la rejilla pulsando "R" o yendo a "Manual Analysis" → "Reset Grid". Después de reajustar, puede mover toda la rejilla con el ratón pulsando adicionalmente "Shift", o poniendo una marca de verificación en "edit entire grid". Tenga en cuenta que sólo podrá mover la rejilla dentro de ciertos límites.





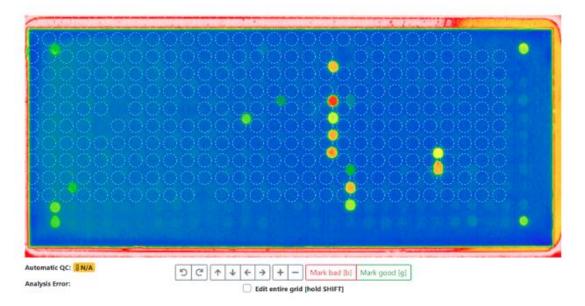


Pulse "R" o "Manual Analysis" → "Reset Grid" y, a continuación, mueva toda la rejilla.


Después de alinear aproximadamente hacia la posición correcta (utilice dos de los puntos de las esquinas como "targets" de alineación), pulse "Manual Analysis"→ "Find grid" o pulse "W", para conducir automáticamente la rejilla más lejos hacia la posición correcta.

Si la cuadrícula sigue sin estar alineada con los puntos, desplázala manualmente varias veces y utiliza "find grid" para girar la cuadrícula en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario, haz clic en los botones "A" o "B" según la imagen de arriba.



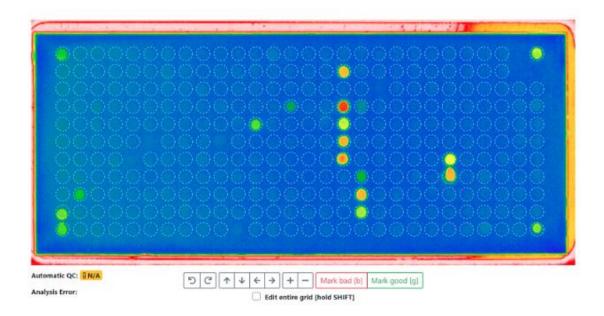


Finalice la búsqueda de cuadrículas y el análisis pulsando "P" o "Manual Analysis" > "Process".

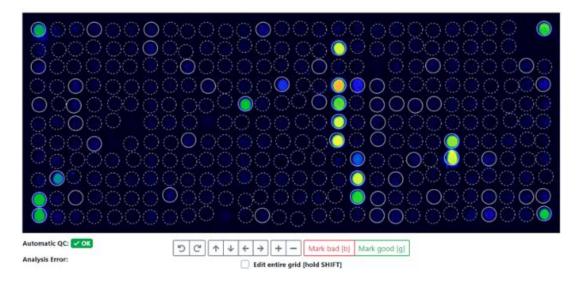


Pulse "P" o "Manual Analysis" → "Process".

Todas las mediciones procesadas tienen información sobre el análisis de imagen en "Show analysis & QC logs".



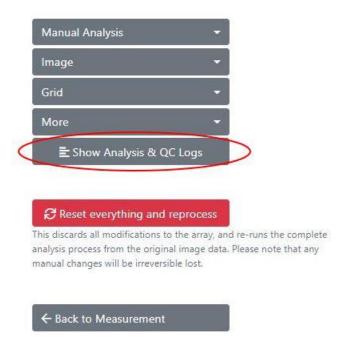


Haga clic en este botón para obtener información sobre el fondo, los valores de punto de control de calidad y los valores de referencia aplicados. Esto resulta especialmente útil si necesita averiguar por qué una medición no ha superado el control de calidad. Para que el control de calidad sea correcto, el fondo debe estar dentro de un determinado intervalo y todos los puntos guía deben alcanzar un determinado valor umbral. Si estos criterios de control de calidad siguen sin cumplirse después de ajustar manualmente los puntos de la imagen, póngase en contacto con su distribuidor local o con el servicio de asistencia técnica de MADx.

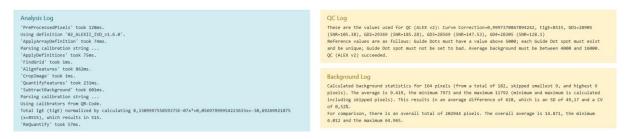




VII.1.8.1 ANÁLISIS DE IMÁGENES

La imagen analítica de la matriz seleccionada se muestra en un código de falso color para permitir una visualización clara. La intensidad del falso color puede ajustarse en tres pasos. Vaya a "Image" y seleccione uno de los tres niveles (corrección cromática baja, corrección cromática media o corrección cromática alta).

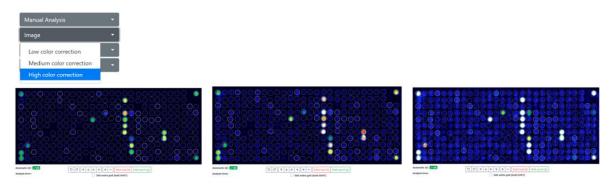

Imágenes superiores de izquierda a derecha: Corrección de color alta (por defecto) - Corrección de color media - Corrección de color baja. Al hacer clic dentro de un punto, se muestran el nombre, las coordenadas x e y de la imagen, el valor bruto y el valor resultante del punto y la relación señal/ruido (SNR).

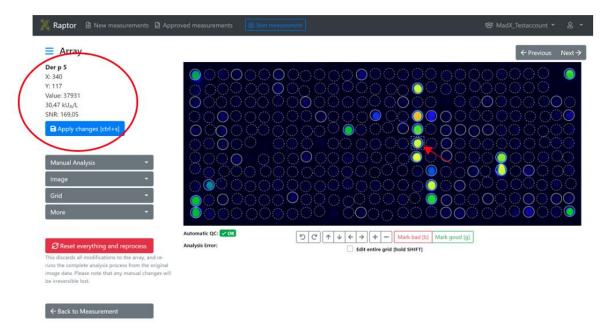

Cada alérgeno está rodeado por un círculo. La representación gráfica del círculo representa la interpretación automática por parte del software o la modificación por parte del usuario:

- 1. Círculo con línea de puntos: aún no analizado o por debajo del punto de corte.
- 2. Círculo con una línea fina continua: punto positivo encontrado automáticamente.
- 3. Círculo con línea continua gruesa: punto fijado como bueno por el usuario.




- 4. Círculo con una línea fina sólida y una X en el centro: punto fijado en mal por el usuario.
- 5. Círculo con una línea naranja gruesa: Puntos que el usuario debe inspeccionar con una mala relación señal/ruido, pero con un resultado cuantitativo superior al límite del sistema. El usuario debe marcar estos puntos como "good" o "bad".
- 6.Las manchas de uso exclusivo para investigación (RUO) están marcadas con una "R" dentro del círculo y no se mostrarán en el informe PDF, pero se exportan en el archivo CSV, EXCEL o ASTM. Los puntos RUO pueden mostrarse mediante cambios en la configuración personal.



El usuario puede editar las manchas:

- Se selecciona un único punto haciendo clic en él.
- Si pulsa simultáneamente "SHIFT" o selecciona "edit entire grid", todos los puntos se seleccionado.
- Se pueden seleccionar varios puntos individuales manteniendo pulsada la tecla "CTRL", o seleccionando "edit multiple features".
- Los puntos seleccionados pueden moverse con las teclas de flecha (izquierda, derecha, arriba, abajo) o con la tecla ratón.
- Los puntos seleccionados pueden ajustarse a Bueno pulsando "G".
- Las manchas seleccionadas pueden ajustarse a Mal pulsando "B".
- Pulsando "H", la cuadrícula puede ocultarse y volver a mostrarse.
- Pulsando "N", se anotan todas las manchas, y el nombre abreviado de cada alérgeno en la pantalla. Esto puede deshacerse pulsando de nuevo "N".

Las dos últimas funciones también pueden utilizarse seleccionando "Grid" → "show or hide grid" y "show or hide names".





VII.1.8.2 RESUMEN DE ATAJOS


Short cut (Atajo)	Execution	Ejecución
R	Reset analysis	Análisis de reajustes
W	Find grid	Buscar cuadrícula
Р	Process	Proceso
G	Set feature to good	Poner la función en bueno
В	Set feature to bad	Fijar característica en malo
N	Annotate allergen features	Anotar las características de los alérgenos
Н	Hide/unhide grid	Ocultar/desocultar rejilla
SHIFT	Select all measurements	Seleccionar todas las medidas

Los puntos marcados en naranja deben ser inspeccionados y fijados en Bueno o Malo por el usuario. De lo contrario, se marcarán con un triángulo naranja con un signo de exclamación en el informe. Si el punto se ha configurado como "good" o "bad", no se mostrará.


Milk				
Cow, milk	Bos d 4	M	α-Lactalbumin	0,38
Cow, milk	Bos d 5	M	β-Lactoglobulin	0,90 🔔
Cow, milk	Bos d 8	M	Casein	6,04
Cow, milk	Bos d_milk	E		3,40

También es posible abrir una imagen del QR-Code, una imagen de la matriz sin procesar o procesada. Para ello, vaya a "More" y seleccione la imagen deseada. También es posible un restablecimiento completo pulsando el botón "Reset everything and reprocess".






Si el usuario cambia la posición o la interpretación del punto o de toda la cuadrícula, se borrarán los datos analíticos y el control de calidad se ajustará a NA. Tras el análisis, pulse "Apply changes" para guardar las modificaciones.

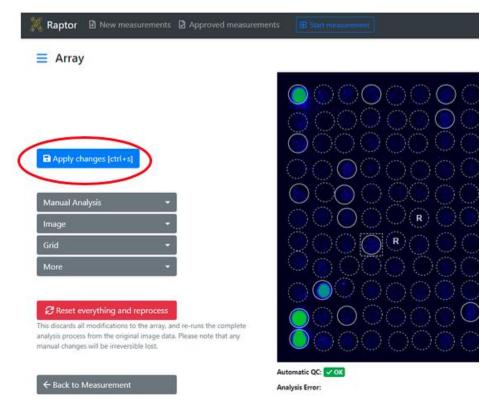

Para volver a la página de detalles de la medición desde el modo de procesamiento de imágenes, pulse "Back to measurement". También puede pulsar "Next/Previous" para ir a la página de edición de la siguiente imagen. Si se ha establecido un filtro en la página de resumen para, por ejemplo, un producto específico, la navegación a través de las Mediciones



utilizando los botones sólo mostrará las que se ajusten a los criterios de filtrado ya aplicados en la lista.

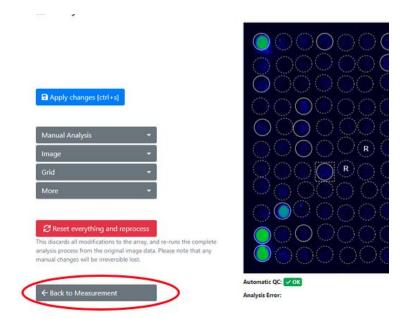

VII.1.8.3 RESULTADOS ANALÍTICOS

En la lista de resultados detallados, debajo de la información del paciente y de la imagen analítica, se mostrarán los resultados de la medición seleccionada. El resultado analítico mostrará una lista que contiene la siguiente información:

- Nombre y especie del alérgeno
- Código alérgeno
- Función bioquímica
- Fuente y vía de exposición
- Extracto de alérgeno o alérgeno molecular
- Nombre de la función
- Valor de IgE expresado en kU_A/I (codificado por colores)
- Valor de IgG expresado en µg/ml (codificado por colores)




						√ All allergens	
↑å Name	Code	Biochemical	Source & Exposure	E/M	Feature	kUA/L	
Acacia Acacia mimosa	t19		Pollen Inhalation	Ε	Aca m	< 0.10	
Acarus siro Acarus siro	d70		Mites Inhalation	Е	Aca s	0.39	
Alder Alnus glutinosa	t100	PR-10	Pollen Inhalation	М	Aln g 1	< 0.10	
Alder Alnus glutinosa	t101	Polcalcin	Pollen Inhalation	М	Aln g 4	6.75	
Almond Prunus dulcis	f20		Plant Food Food	Е	Pru du	< 0.10	
Alternaria alternata Alternaria alternata	m229	Alt a 1-Family	Microorganisms & Spores Inhalation	М	Alt a 1	9.21	
Alternaria alternata Alternaria alternata	m230	Enolase	Microorganisms & Spores Inhalation	М	Alt a 6	< 0.10	

Haciendo clic en el menú desplegable "All allergens/Only positive allergens", se puede seleccionar la información que se mostrará en la ventana de resultados analíticos. Esto es independiente de los resultados que se muestran en el informe PDF.




Al hacer clic en el nombre de uno o varios alérgenos de la lista de resultados de alérgenos, los puntos correspondientes de la imagen de matriz se resaltan con un recuadro rectangular rojo.

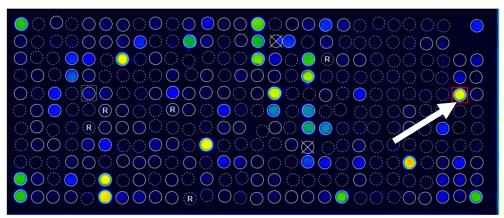

VII.1.9 RESUMEN DE MEDICIONES


Las mediciones nuevas y no aprobadas se muestran en el resumen "New Measurements". Con un desplegable en la parte inferior de la página, puede establecer el número de mediciones mostradas en 25, 50, 100 o 250.



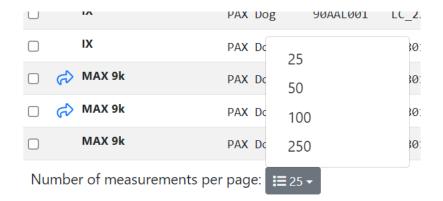


La página "Nueva medición" también muestra la siguiente información para cada medición:

- Source of measurement (Fuente de medición)
- QC status (Estado del control de calidad)
- Tags (Etiquetas)
- Product type (Tipo de producto)
- QR code (Código QR)
- Sample code (Código de muestra)
- Patient code (Código del paciente)
- Patient name (Nombre del paciente)
- Analysis Date (Fecha de análisis)

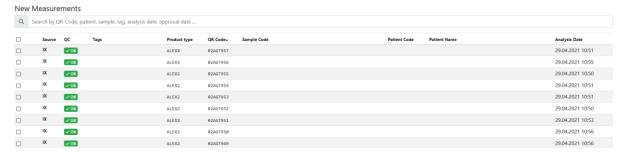


Haciendo clic en el código QR o en la fecha del análisis se accede al área de detalles de la medición. La información del paciente, el código de la muestra y las etiquetas también pueden introducirse en la página de resumen. Para ello, basta con hacer clic en el campo correspondiente de la medición e introducirlo. Pulse el botón "Tab" para introducir automáticamente el siguiente campo y su entrada se guardará.

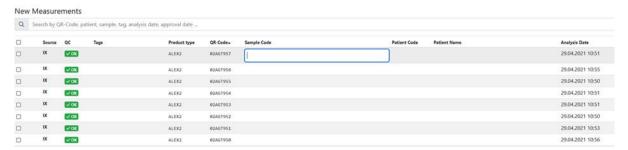




Las etiquetas pueden añadirse o eliminarse de varias mediciones a la vez utilizando el menú desplegable.

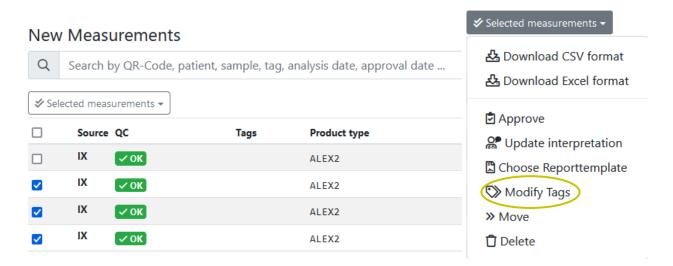


Para volver a procesar varias mediciones a la vez, seleccione las mediciones que desea volver a procesar y abra el menú desplegable de la parte superior y elija "Re-Process".

New Measurements

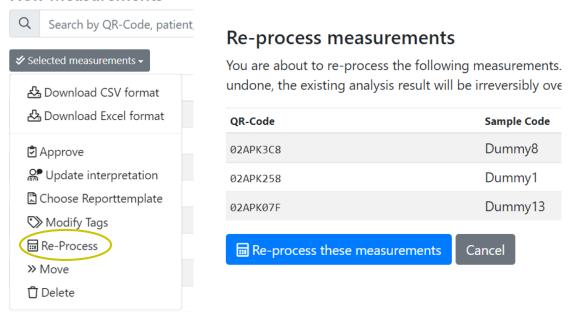


En el campo de búsqueda, las mediciones pueden buscarse por su etiqueta, tipo de producto, código QR, código de muestra, código y nombre del paciente, así como por la fecha de análisis.





Es posible duplicar el QR-Code y los datos de medición en el repositorio de datos si el cartucho se adquiere varias veces. Sin embargo, esto se indica mediante un triángulo con un signo de exclamación durante la medición.


New Measurements

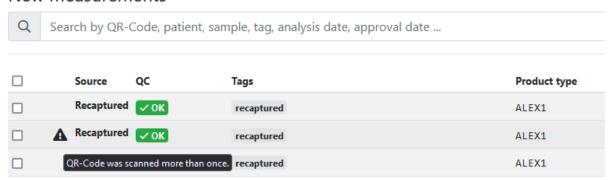

VII.1.10 APROBACIÓN Y EXPORTACIÓN DE MEDICIONES

Tras el análisis y la revisión minuciosa de los resultados, las mediciones pueden aprobarse por dos vías Sin embargo, asegúrese de resolver los puntos dudosos antes de aprobar una medición; véase también VII.1.8.1:


1. Se pueden seleccionar una o varias mediciones marcándolas y luego aprobarlas en el menú desplegable de un paquete:

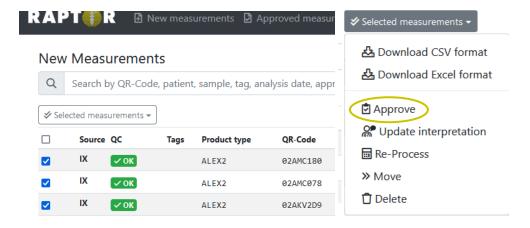

Las mediciones no aprobadas también pueden descargarse en formato CSV o EXCEL.

 Una medición también puede aprobarse en la página de detalles de una medición. Basta con hacer clic en "Save and approve".



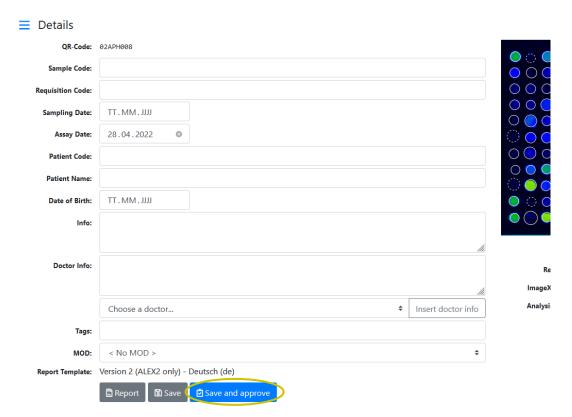

Si el control de calidad de una medición es "OK", la medición pasará a la pestaña "Approved Measurements" una vez aprobada. Si el control de calidad de una medición es "Failed", el usuario recibirá una notificación de que el "Measurement QC is not OK". Además, también se indicará en el informe que el control de calidad interno (comprobación de plausibilidad de GD y señal de fondo) no se ha realizado correctamente.


Approve measurements You are about to approve the following measurements. There are measurements with one or more warnings. Please make sure to double-check these measurements before approval. QR-Code Sample Code Analysis Date 02AKV0335 28.04.2022 11:14

Las mediciones aprobadas se almacenan en la sección "Approved Measurements". Con un desplegable en la parte inferior de la página, puede establecer el número de mediciones mostradas en 25, 50, 100 o 250. No se puede modificar ni añadir información del paciente a las mediciones aprobadas. Los detalles/resultados de una medición pueden visualizarse haciendo clic en una medición. También se pueden mostrar las características de la imagen, pero ya no se pueden ajustar.





Los resultados de las mediciones seleccionadas en la sección de mediciones aprobadas pueden descargarse como informe PDF, como archivo EXCEL, CSV o ASTM. Los valores inferiores a 0,1 kU_A se mostrarán como <0,1, y los superiores a 50 kU_A como >50 en lugar del valor absoluto.

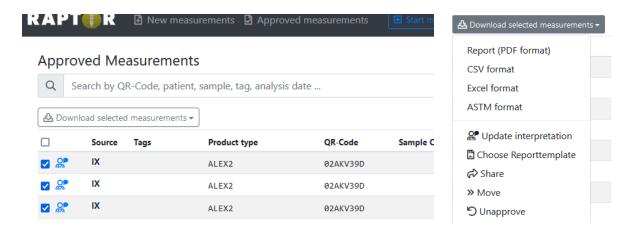


Si se solicita la exportación de una mayor cantidad de datos, por ejemplo varios informes en formato .pdf, se generará un enlace de descarga de la exportación en una ventana aparte. El proceso de exportación se ejecuta en segundo plano y puede verse haciendo clic en el menú de la esquina superior derecha. La exportación finalizada puede descargarse haciendo clic en "download".




Para iniciar una exportación de varias mediciones se puede hacer clic en "Exportaciones" y, a continuación, en "Exportar varias mediciones".



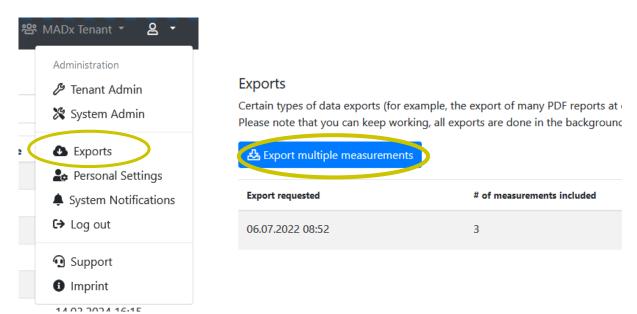

Tras seleccionar los filtros adecuados y hacer clic en "Buscar mediciones", se mostrará el número de mediciones encontradas. Después de hacer clic en "Iniciar exportación", el usuario será dirigido de nuevo a la página de Exportaciones y verá la Exportación solicitada lista para Descargar. Si el usuario desea cambiar los filtros, puede hacer clic en el botón "Atrás", RAPTOR SERVER recuerda el filtro establecido anteriormente.

Exportar varias mediciones

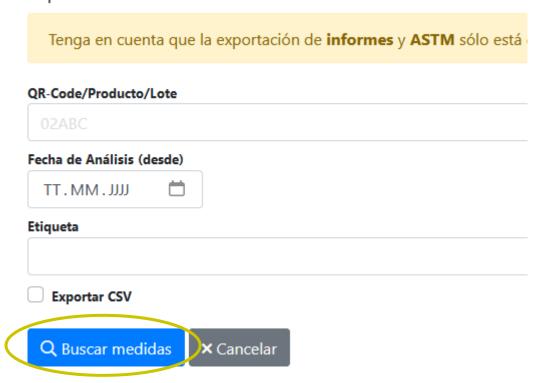



Exportar varias mediciones

Tenga en cuenta que la exportación de informes y ASTM sólo está dis


QR-Code/Producto/Lote 02aa Fecha de Análisis (desde) TT. MM. JJJJ Etiqueta Exportar CSV ✓ Volver

5 Medidas encontradas que coinciden con sus criterios



VII.2 INFORME

Los informes pueden personalizarse haciendo clic en "Tenant Admin" → "Manage report templates" y luego en "Add new report template".

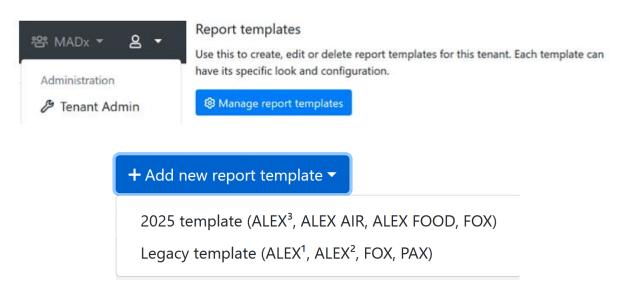

Hay dos tipos de plantillas disponibles: la plantilla heredada para productos como ALEX, ALEX² y FOX, y la plantilla 2025 para los productos más nuevos como ALEX³, ALEX Air, ALEX Food y también FOX.

VII.2.1 CREACIÓN DE UNA PLANTILLA DE INFORME PERSONALIZADA (PLANTILLA 2025)

El Configurador de plantillas de informes consta de seis fichas, que pueden utilizarse para personalizar una plantilla de informe: Configuración general, diseño de la cabecera, contenido, nombre del archivo PDF, marca y firmas.

VII.2.1.1 CONFIGURACIÓN GENERAL DEL MODELO DE INFORME PERSONALIZADO (PLANTILLA 2025)

En la ficha «Configuración general» se pueden seleccionar los siguientes ajustes:

- Nombre del modelo de informe
- Idioma por defecto (puede cambiar el idioma para cada informe por separado)
- Productos admitidos
- Tamaño del PDF



VII.2.1.2 DISPOSICIÓN DE LA CABECERA PARA LA PLANTILLA DE INFORME PERSONALIZADA (PLANTILLA 2025)

En la ficha «Diseño de cabecera» se puede configurar el contenido y el orden de la cabecera. La siguiente información puede añadirse mediante desplegables:

- Fecha de la muestra
- Fecha del ensayo
- Fecha de análisis
- Fecha de aprobación
- Fecha de impresión
- Código paciente
- Código de la muestra
- Nombre del paciente
- Fecha de Nacimiento
- Código QR
- Alérgenos/Antígenos
- Método de prueba
- Información médica
- Texto de información adicional
- Código de solicitud
- Aprobado por
- Probado por
- Información del dispositivo

Si el desplegable se deja en «Ninguno», no se mostrará ningún texto en esa posición.

VII.2.1.3 CONTENIDO DE LA PLANTILLA DE INFORME PERSONALIZADA (PLANTILLA 2025)

En la tarjeta «Contenido» se pueden seleccionar los siguientes ajustes:

- Filtro de resultados: se pueden especificar los alérgenos que aparecen en el informe (todos los alérgenos, sólo alérgenos positivos, sólo alérgenos negativos)
- Orden de clasificación de los alérgenos: Los detalles de los alérgenos en el informe (en un grupo de alérgenos) se pueden ordenar de tres maneras diferentes:
 - Orden alfabético por códigos de alérgenos
 - Descendiendo del valor más alto al más bajo
 - Orden alfabético por nombre del alérgeno (nombre común)
- Incluir QR-Code para el portal del paciente: para acceder al portal del paciente se puede imprimir un QR-Code en el informe:
 - Ninguno
 - Arriba y abajo
 - Superior
 - Inferior



- Incluir IgE total con tres opciones:
 - No incluir
 - Arriba
 - Inferior
- Incluir interpretación (RAVEN)
 - Véase el capítulo correspondiente. Aquí se puede seleccionar si una interpretación se incluirá automáticamente en el informe, o sólo a petición.
- Información de reacción cruzada: Seleccionando «incluir información de reactividad cruzada», se añadirán frases explicativas al final del informe describiendo aquellas familias de alérgenos que den positivo en la primera página. (véase «alérgenos de reactividad cruzada»). Es posible incluir la información sólo como texto o la información y una tabla de todos los alérgenos positivos).

VII.2.1.4 NOMBRE DE ARCHIVO PDF PARA LA PLANTILLA DE INFORME PERSONALIZADA (PLANTILLA 2025)

En la tarjeta «Nombre de archivo PDF» se pueden seleccionar las siguientes opciones para el nombre del archivo:

- Incluir código QR de medición
- Incluir código de paciente
- Incluir nombre del paciente
- Incluir código de muestra
- Incluir fecha y hora

También se puede definir un patrón manual, en cuyo caso se ignorará cualquier otra configuración.

VII.2.1.5 MARCA PARA LA PLANTILLA DE INFORME PERSONALIZADA (PLANTILLA 2025)

En la ficha «Marca» se pueden seleccionar los siguientes ajustes:

- Color personalizado: los colores de la cabecera pueden personalizarse en toda la paleta de colores.
- Logotipos: Además de los logotipos a ambos lados de la cabecera de la página principal, se puede añadir un logotipo en miniatura en la cabecera de todas las páginas. Por defecto, se trata de una miniatura del logotipo de la cabecera del lado izquierdo.

VII.2.1.6 FIRMAS PARA LA PLANTILLA DE INFORME PERSONALIZADA (PLANTILLA 2025)


En la tarjeta «Firmas» se pueden añadir hasta 3 imágenes al en del informe en forma de firmas.



Tras el cambio, la plantilla de informe puede guardarse pulsando el botón «Guardar».

Una plantilla de informe se puede duplicar utilizando el botón «Duplicar» situado en la parte inferior de la página. La plantilla de informe actual se duplicará y la copia se cargará automáticamente, lo que se puede ver en el nombre de la plantilla de informe:

Edit report template

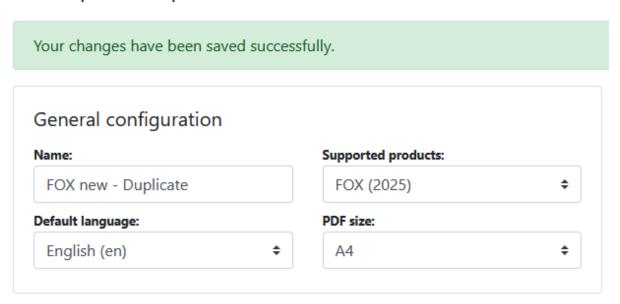

VII.2.2 CREACIÓN DE UNA PLANTILLA DE INFORME PERSONALIZADA (PLANTILLA HEREDADA)

El Configurador de plantillas de informes consta de cuatro pestañas, que pueden utilizarse para personalizar una plantilla de informe: General, Diseño, Encabezado y Contenido.

Add a new report template




VII.2.2.1 CONFIGURACIÓN GENERAL DE LA PLANTILLA DE INFORME PERSONALIZADA (PLANTILLA HEREDADA)

En la pestaña "General" se pueden seleccionar los siguientes ajustes:

- Nombre del modelo de informe
- Plantilla base
- Idioma preferido (puede cambiar el idioma de cada informe por separado)




Configure report template "New report template"

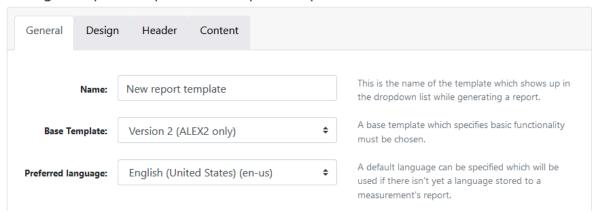

- Nombres en PDF:
 - Tipo de configuración: "Automatic" → elija entre las siguientes opciones:
 - Patient ID (Identificación del paciente)
 - Patient Name (Nombre del paciente)
 - Sample Code (Código de muestra)
 - Measurement QR-Code (Medición QR-Code)
 - Date & Time (Fecha y hora)
 - Tipo de configuración: "Manual" → selecciona las opciones como prefieras
 Ejemplo: Report {PatientID} {DateAndTime}
- Pie de página: Se puede añadir texto al pie de todas las páginas



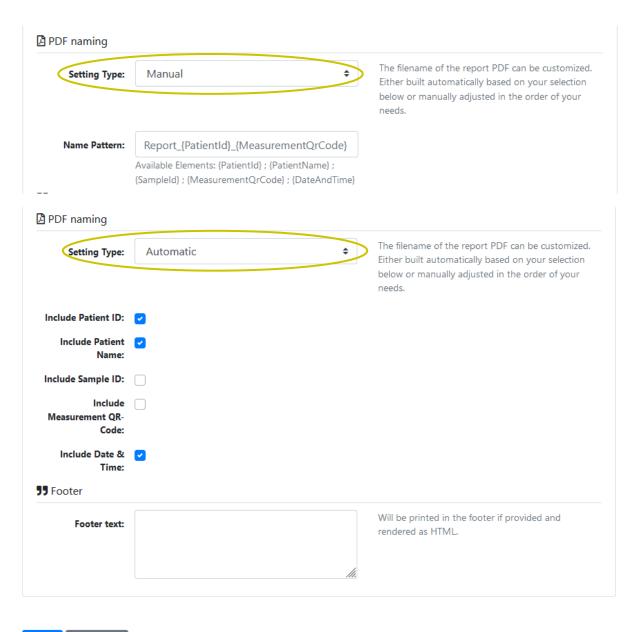

Save ← Cancel




VII.2.2.2 AJUSTES DE DISEÑO PARA LA PLANTILLA DE INFORME PERSONALIZADA (PLANTILLA HEREDADA)

En la pestaña "Design" se pueden seleccionar los siguientes ajustes:

- Formato PDF
- Fuente
- Imagen de fondo: es posible añadir una marca de agua de fondo a todas las páginas.

Configure report template "New report template"

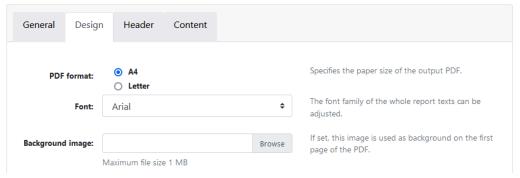

- Paleta de colores: Los colores base de la plantilla y de las clases resultantes pueden ser personalizados en toda la paleta de colores
- Logotipos: Además de los logotipos situados a ambos lados de la cabecera de la portada, una miniatura puede añadirse a la cabecera de todas las páginas. Por defecto, se trata de una miniatura del logotipo logotipo de cabecera en el lado izquierdo.
- Firma: Además, se puede cargar una imagen de una firma para añadirla en el fin del informe.
- Indicador de intensidad personalizado (un SVG personalizado para mostrar la intensidad del alérgeno puede ser añadido)



Color settings			
Color palette:	Palette 1	•	
Color 1:			
Color 2:			
Color 3:			
Color 4:			
First level headline color:			
Second level headline color:			
Third level headline color:			
R Logos			
Logo (left):	Bro	owse	This logo will appear on the top left corner of the
	Maximum file size 1 MB		first page of the report.
Text (center):			This text will appear either on the left, right, or center of the top of the first page (depending on your configured logos). Supports the placeholders {{ PATIENT_PORTAL_QRCODE }} and {{ PATIENT_PORTAL_URL }} to dynamically insert measurement information.
lana (riabb).	0	///.	This logo will appear on the top right corner of the
Logo (right):	Maximum file size 1 MB	owse	first page of the report.
			This logo is used on all detail pages. If not set, the
Small logo:	Maximum file size 1 MB	owse	default logo is used.
≱ Signatures			
Left:	Bro	wse	This signature or image will appear on the last page,
	Maximum file size 1 MB		left aligned.
Center:	Bro	wse	This signature or image will appear on the last page,
-	Maximum file size 1 MB	WSC	center aligned.
Diela			This signature or image will appear on the last page,
Right:	Maximum file size 1 MB	owse	right aligned.
▲ Indicators			
Custom intensity indicator:			A custom SVG for displaying allergen intensity can be pasted here. Will be styled according to specified colors. The SVG element must contain the attributes width and height with a minimum dimension of 16
		fi.	for correct display in PDF. SVGs paths which should be colored must require the colorize class as well as a fill defined in the defs segment of the SVG.



VII.2.2.3 CONFIGURACIÓN DEL ENCABEZADO DE LA PLANTILLA DE INFORME PERSONALIZADA (PLANTILLA HEREDADA)

El contenido y el diseño de la cabecera pueden configurarse para que aparezcan en el lado izquierdo o derecho mediante una tabla de 8x2. La siguiente información puede añadirse mediante desplegables a cada posición de la tabla 8x2:

- Sample Date (Fecha de la muestra)
- Assay Date (Fecha del ensayo)
- Analysis Date (Fecha del análisis)
- Approval Date (Fecha de aprobación)
- Print Date (Imprimir fecha)
- Patient ID (Identificación del paciente)
- Sample Code (Código de muestra)
- Patient Name (Nombre del paciente)
- Date of Birth (Fecha de nacimiento)
- QR-Code (Código QR)
- Amount of tested allergens (Cantidad de alérgenos analizados)
- Test method (Método de ensayo)
- Doctor information (Información médica)
- Additional Info Text (Texto de control de calidad)
- Información adicional)
- Requisition Code (Código de solicitud)
- Approved by (Aprobado por)
- Tested by (Probado por)

Si el desplegable se deja en "None", no se mostrará ningún texto en esa posición. Lo mismo ocurre si no se rellena ninguna información para una posición específica en los detalles de la medición.

Además, si lo desea, puede añadir un titular personalizado marcando la casilla situada junto al cuadro de texto que debe personalizarse.



Configure report template "New report template" Design Header Content Left half Right half Custom headline Custom headline Patient Name Doctor Information Patient Name None Custom headline None Date of Birth **‡ ‡** Sample ID None Additional Info text QR-Code None Analysis Date Amount of tested allergens Quality Control text


VII.2.2.4 CONFIGURACIÓN DEL CONTENIDO DE LAS PLANTILLAS DE INFORME PERSONALIZADAS (PLANTILLA HEREDADA)

En la pestaña "Content" se pueden seleccionar los siguientes ajustes:

- Alérgenos
- Orden de clasificación de los alérgenos: Los detalles de los alérgenos en el informe (en un grupo de alérgenos) pueden ser clasificadas de tres maneras diferentes:
 - Orden alfabético por códigos de alérgenos
 - Descendiendo del valor más alto al más bajo
 - Ordenados alfabéticamente por nombre del alérgeno (nombre común)
- Incluir un resumen de los alérgenos
- Incluir tipo de producto
- Incluir IgE total con tres opciones:
 - No incluya
 - Tras los resultados de alérgenos específicos
 - En portada
- Información de reacción cruzada: Seleccionando "include cross-reactive information", se añadirán frases explicativas al final del informe en las que se describan esos familias de alérgenos que dan positivo en la primera página. (véase "cross-reactive allergens"). En es posible incluir la información como texto solamente o la información y una tabla de todos los alérgenos positivos).
- Incluir interpretación (RAVEN)
- Véase el capítulo correspondiente. Aquí se puede seleccionar si una interpretación será incluidos automáticamente en el informe, o sólo previa solicitud.
- Información adicional impresa en el informe bajo la lista de resultados:
 - Fecha de aprobación
 - Fecha del ensayo




- Información médica
- Imprimir fecha
- Información del informe
- Fecha de la muestra

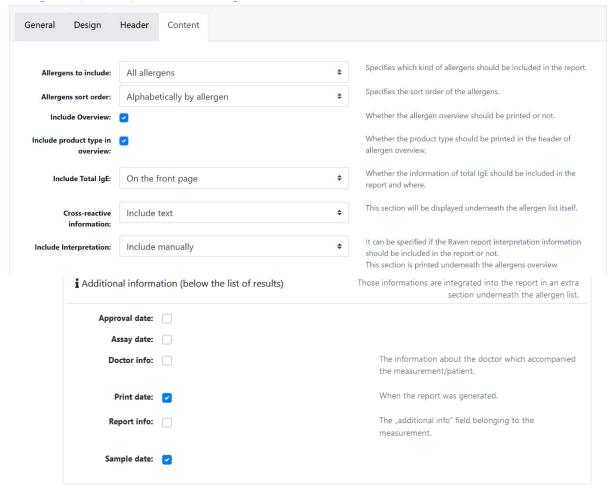

Tras el cambio, la plantilla de informe puede guardarse pulsando el botón "Save".

Una plantilla de informe se puede duplicar utilizando el botón «Duplicar» situado en la parte inferior de la página. La plantilla de informe actual se duplicará y la copia se cargará automáticamente, lo que se puede ver en el nombre de la plantilla de informe:

Configure report template "New report template - Duplicate"

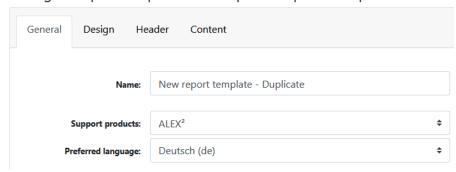




Están disponibles los siguientes idiomas:

- Azerbaiyán
- Albanés
- Alemán
- Árabe
- Árabe (Arabia Saudí)
- Búlgaro
- Chino
- Chino (Hong Kong)
- Croata
- Checa
- Eslovaquia
- Eslovenia
- Español
- Español (Latinoamérica)
- Español (México)
- Estonia
- Farsi
- Farsi (Irán)
- Francés
- Georgiano
- Griego
- Hindi
- Holandés
- Húngaro
- Inglés
- Inglés (India)
- Inglés (Reino Unido)
- Inglés (Estados Unidos)
- Italiano
- Kazajo
- Coreano
- Letón
- Lituania
- Macedonio
- Noruega
- Persa
- Polaco
- Portugués
- Portugués (Brasil)
- Rumano
- Ruso




- Serbio
- Sueco
- Tailandés
- Turco
- Ucraniano

Para definir su plantilla "default", que se utiliza como plantilla estándar, necesita tener los derechos de usuario correspondientes. A continuación, si va a "Configure Tenant" en el área Tenant Admin, puede seleccionar el idioma por defecto y las plantillas para cada tipo de prueba.

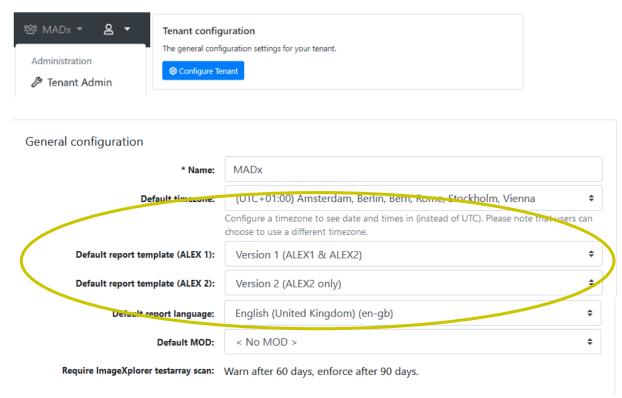


El informe de una medición no aprobada puede consultarse haciendo clic en el código QR de la medición en la pestaña "New Measurements"; seleccione la plantilla de informe deseada y haga clic en "Report".



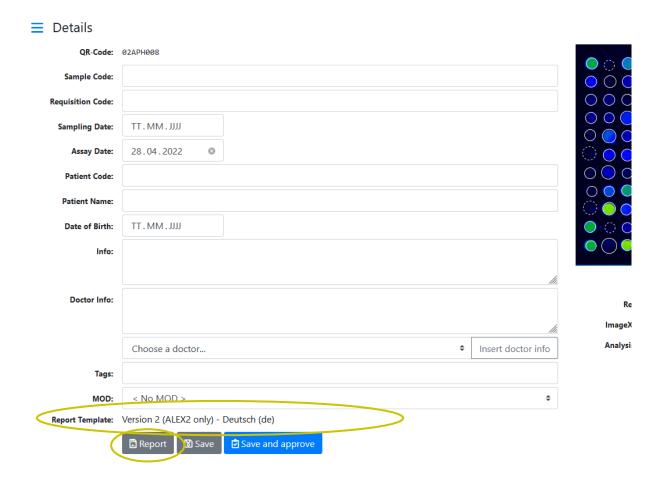


A continuación, verá una vista previa del informe, donde podrá seleccionar una plantilla de informe (predeterminada o personalizada) y establecer el idioma predeterminado. Sin embargo, no es posible descargar este informe en PDF. Para ello, es necesario aprobar primero la medición.

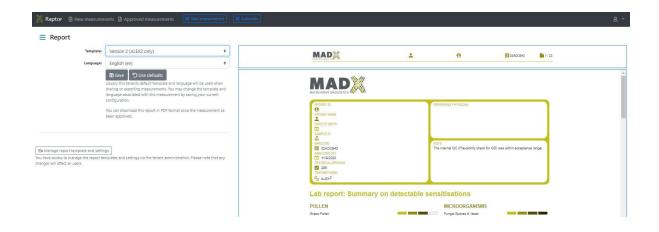



Las mediciones aprobadas pueden descargarse juntas o individualmente. Para descargar las mediciones juntas, vaya primero a la pestaña "Approved Measurements" y seleccione las mediciones que desea descargar. A continuación, seleccione Informe PDF en el menú desplegable y se guardará localmente en su ordenador una carpeta zip con los Informes PDF.

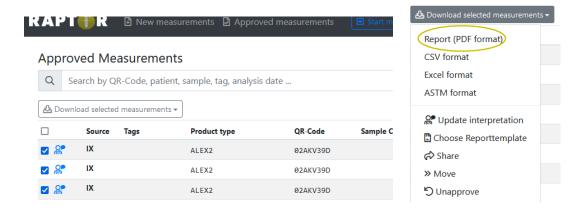


Si hace clic en una medición, accederá al área de detalles de esta medición. Desde allí, también puede visualizar una vista previa del informe y cambiar la configuración de la cabecera y el idioma de este informe. A continuación, puede descargar el informe directamente desde allí.



Details QR-Code: 02AKV39D Sample Code: Requisition Code: Sampling Date: Assay Date: 27.09.2021 Patient Code: Patient Name: Date of Birth: Info: **Doctor Info:** Analysis: 27.09.2021 15:39 Approved: 27.09.2021 15:39 ImageXplorer: 23167844 Tags: MOD: Report Template: Version 2 (ALEX2 only) - Deutsch (de) 🚣 Download 🕶 **᠍** Save



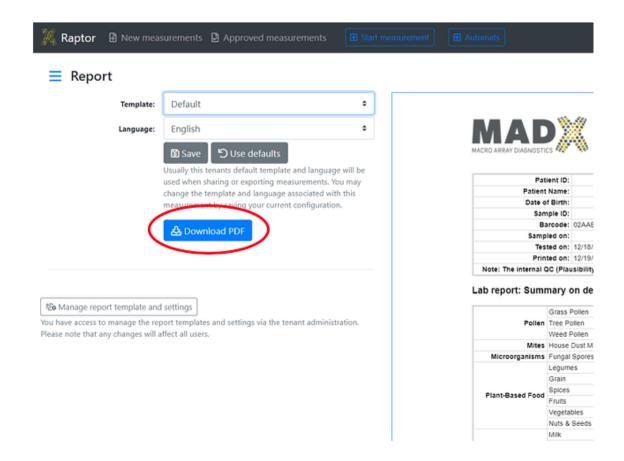


VII.2.3 SOLICITUD DE ORIENTACIÓN INTERPRETATIVA

Se ha implementado un módulo de software especial para apoyar la interpretación de los resultados: Guía de interpretación de RAVEN.


Una consulta de interpretación con RAVEN es posible tanto para mediciones aprobadas como no aprobadas. El informe sólo puede descargarse para las mediciones aprobadas. La interpretación se añade automáticamente al informe, si se elige una plantilla de informe para la que se haya especificado la opción "Automatically include interpretation".

En caso de que en su modelo de informe se haya seleccionado la opción de interpretación "Include manually triggered interpretation", deberá activar la interpretación manualmente para una medición accediendo a la página de detalles de una medición, haciendo clic en el icono de menú y seleccionando "View interpretation".






Se abre una nueva página que le permite elegir el conjunto de reglas que desea utilizar para interpretar los resultados.

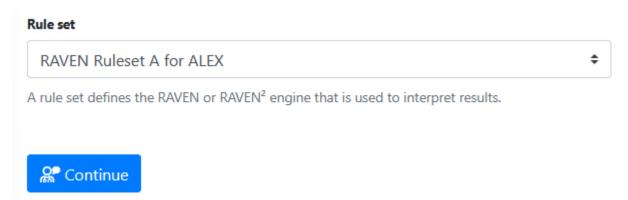

Para "RAVEN Ruleset A and B for ALEX" se abre una página en la que se pueden introducir los ajustes, como el idioma, la información específica del paciente (edad, sexo, entorno) y los síntomas del paciente.



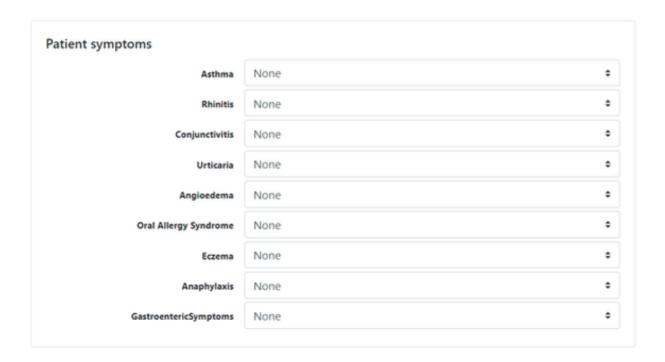






Para "RAVEN² for ALEX" se puede seleccionar el idioma y la región antes de continuar con la anamnesis, proporcionada en forma de cuestionario.




Interpretation settings

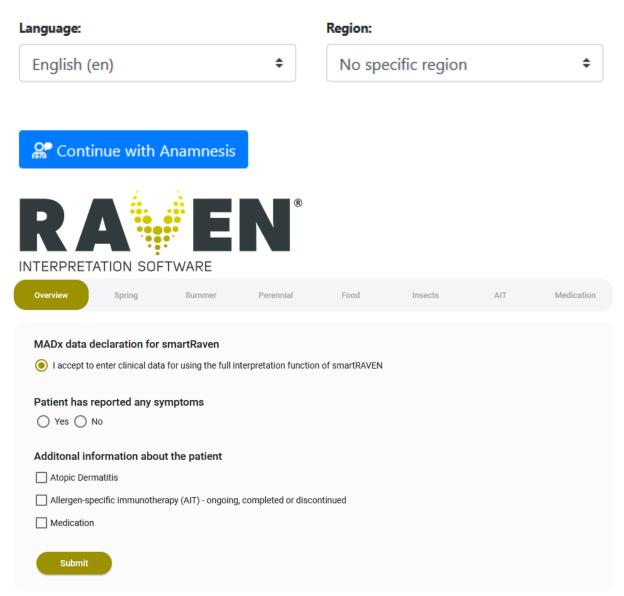

Al hacer clic en "Request interpretation" en el caso de "RAVEN Ruleset A and B for ALEX" o en "Submit" en el caso de "RAVEN² for ALEX", se generará la interpretación.




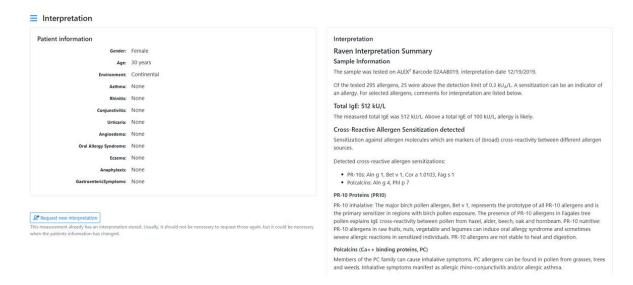

La interpretación se insertará al final del informe y también se mostrará en una ventana de vista previa. Las mediciones que ya han recibido una interpretación se indican mediante el

siguiente símbolo: Tras hacer clic en el símbolo, la interpretación puede revisarse como se ha indicado anteriormente, con la posibilidad de actualizar (solicitar una nueva) o eliminar la interpretación existente.


Además, también se pueden lanzar varias consultas de interpretación por lotes. Si selecciona varias mediciones en la página de resumen (tanto de mediciones no aprobadas como aprobadas) y hace clic con el ratón en las 3 líneas de la esquina superior izquierda, puede seleccionar "Update interpretation" para realizar la consulta por lotes.

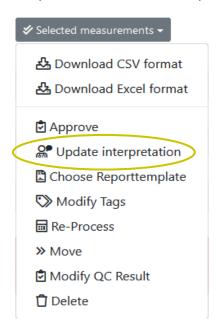



VII.2.4 MÚLTIPLEX A LA CARTA

El usuario tiene la opción de elegir un grupo definido de alérgenos que se tendrán en cuenta para el resultado. En la ventana de detalles de una medición, se puede seleccionar un panel predefinido. Si se selecciona un panel, el software sólo mostrará las manchas de alérgenos y los resultados del panel seleccionado. Para restablecer la selección y mostrar todos los alérgenos, seleccione "no MOD".

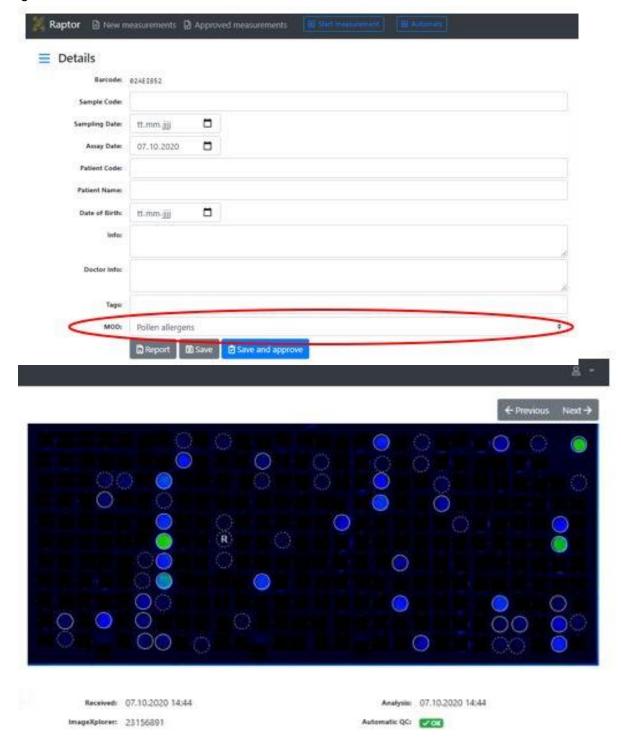




¡ATENCIÓN! Tras la aprobación de la medición, los resultados de alérgenos, que no se incluyeron en el MOD, se borrarán tanto de la imagen como de los datos y, por tanto, tampoco serán visibles en el informe.

Se pueden seleccionar los siguientes paneles de alérgenos como MOD predefinidos:


- AIT pertinente
- ALEX² sin venenos
- Alimentos de origen animal
- Cucarachas, ácaros e insectos
- Alérgenos de contacto
- Huevo y leche
- Alérgenos alimentarios
- Alérgenos de la fruta
- Animales peludos
- Alérgenos inhalatorios
- Legumbres, frutos secos y semillas
- Alérgenos moleculares
- Alimentos de origen vegetal
- Alérgenos del polen
- Alérgenos venenosos

Cada inquilino puede definir sus propios paneles MOD. Para ello, vaya a "Tenant Admin" \rightarrow haga clic en "Manage MODs" y cree un panel MOD específico para cada inquilino haciendo clic en "Add new MOD". Para cada tipo de producto se puede definir un MOD.

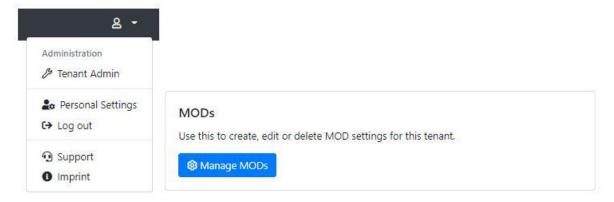


Introduzca el nombre del panel, el tipo de producto, el tipo de MOD (sólo alérgenos especificados o todos los alérgenos excepto los especificados) y los alérgenos (por su código) que desea incluir en el panel.



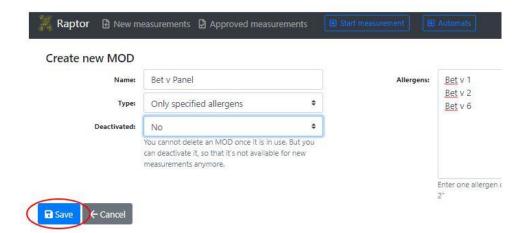

Además, en la configuración del tenant (Tenant Admin → Configure Tenant) hay tres ajustes MOD disponibles.

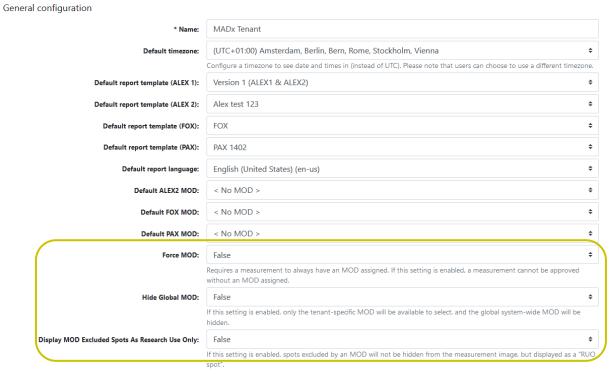


Require ImageXplorer ConfigXplorer scan: Warn after 60 days, enforce after 90 days.



 Force MOD: Si esta opción está activada, se debe seleccionar un MOD al guardar o aprobar una medición.





 Hide Global MOD: Cuando esta opción es verdadera, los MODs globales no se muestran en la lista desplegable de MODs al editar una medida.

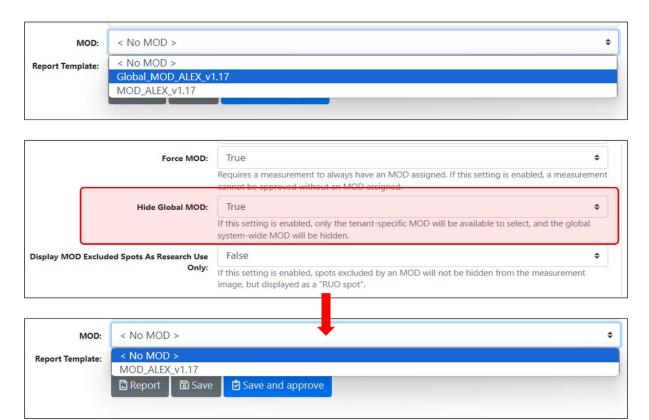




 Display MOD Excluded Spots As Research Use Only: Si esta opción es verdadera, los puntos ocultos por el MOD se mostrarán como RUO en las vistas Detalles y Array de la medición. (En la página de ajustes personales se debe configurar Research Spots como Show).

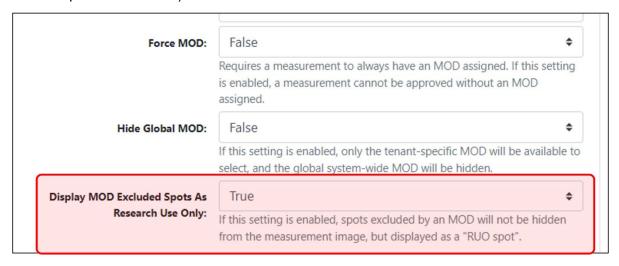

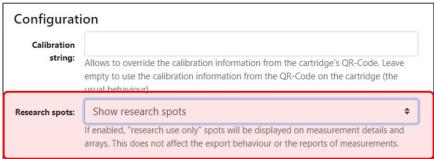

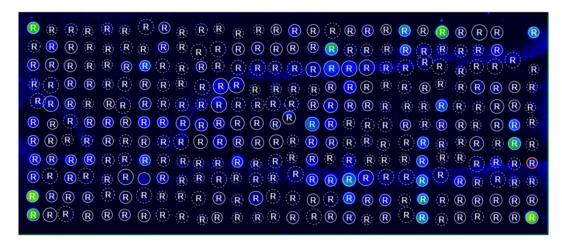





VII.3 MEDICIONES DE MUESTRAS DE CALIDAD

«Lyphochek Allergen IgE, Panel A» de Bio-Rad Laboratories (REF 12000142, REF 12000144) puede utilizarse como muestra de calidad. Los criterios de aceptación para los alérgenos seleccionados del lote Lyphochek respectivo (lote 22670, lote 22660, lote 22650, lote 22640) se almacenan en el RAPTOR SERVER.

Las nuevas mediciones de las muestras de calidad se muestran en la vista general "New Measurements". Si la medición está marcada en rojo, los valores medidos de los anticuerpos individuales están fuera de los intervalos de aceptación definidos. Si la medición está marcada en verde, se han cumplido todos los criterios de aceptación.



La vista detallada de una medición muestra la imagen del análisis con todos los alérgenos. Sólo estos alérgenos se muestran en esta imagen y esta MOD específica no se puede modificar. Además, la imagen de análisis también está marcada como muestra de control de calidad.

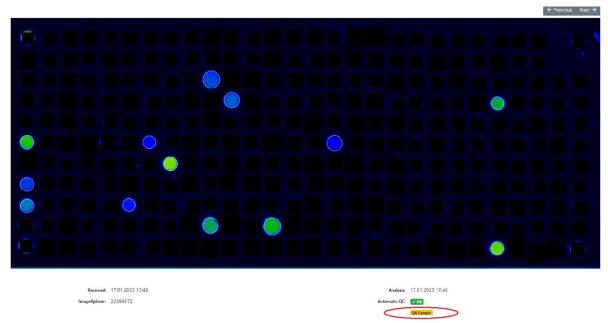

Los resultados detallados de las mediciones se pueden encontrar en forma de tabla o gráfico en el módulo QC del dispositivo ("Tenant Admin" → "Manage ImageXplorers" o "Manage MAX Devices"). Si el dispositivo está conectado al RAPTOR-SERVER, el módulo QC también puede controlarse directamente a través del enlace del panel de control (véase la página VII.1.1).



MAX devices for "MADx Tenant"




Se puede cargar un informe de una medición de muestras de calidad mediante la opción "List View" y "View results".

La opción "Chart Trend View" muestra todos los criterios de aceptación de la en forma de gráfico, con el intervalo de aceptación también marcado en color (con al menos dos mediciones). Para proporcionar más información para la evaluación, el CV, la Desviación Estándar y el Valor Medio están disponibles por defecto para cada alérgeno. También es posible eliminarlos del gráfico haciendo clic en su nombre en la descripción debajo del gráfico.

Fel d 1 with QC-Sample 31 and Lot 00001



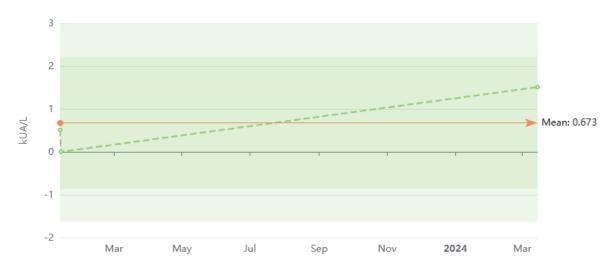


<u>CV</u>: 114,08 % <u>SD</u>: 0,768 kUA/L

Tras un número mínimo de mediciones (p. ej.: 20 mediciones), se pueden controlar los intervalos específicos del aparato (2 y 3 desviaciones estándar). De este modo, se pueden determinar con precisión los intervalos específicos de laboratorio para cada alérgeno Lyphochek.



VII.4 BORRAR MEDICIONES

Las mediciones no aprobadas (nuevas) pueden borrarse seleccionando las mediciones deseadas y eligiendo "Delete" en el menú desplegable. Antes de borrar definitivamente una medición, aparece un aviso de que debe ser aprobada. Las mediciones eliminadas se borrarán permanentemente y no podrán restaurarse.

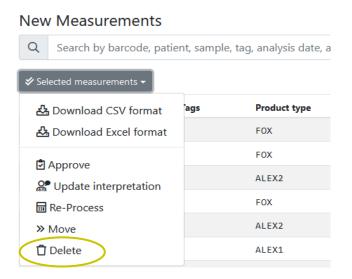


Delete measurements You are about to delete the following measurements. Please note that this action is irreversible and cannot be undone. Barcode @ZAAB169 Analysis Date @ZAAB169 Cancel

También es importante saber que la eliminación de nuevas mediciones está vinculada al derecho específico del usuario "Edit Measurements". Los usuarios administradores de inquilinos con este derecho o los usuarios administradores del sistema pueden eliminar nuevas mediciones. Los usuarios administradores de inquilinos sin este derecho no tienen esta opción. Pero cualquier usuario puede solicitar la eliminación de las mediciones en la GUI del RAPTOR SERVER (medición abierta, en la parte inferior derecha). Esta solicitud también puede ser retirada.




🛱 Request delete






Los usuarios administradores del sistema recibirán esta solicitud (función especial en los derechos de administrador del sistema: "Measurement delete/unapproval log & requests") y podrán aceptarla o rechazarla.

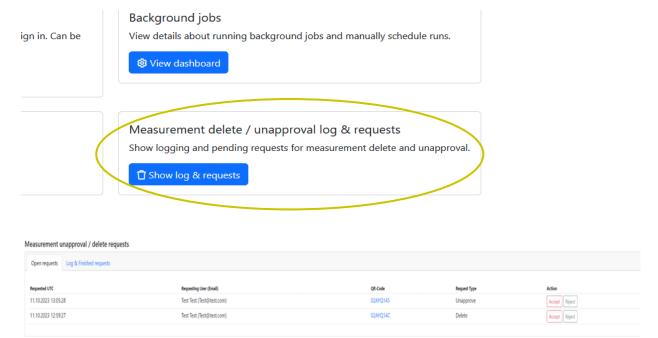

Para una solicitud de desaprobación, los usuarios pueden seguir la misma funcionalidad ("request unapprove"; medida abierta, abajo a la derecha). Una vez más, los usuarios administradores del sistema reciben estas solicitudes y pueden aceptarlas o rechazarlas.

Cualquier supresión o no aprobación se registrará en la base de datos, que se mantiene en línea con los requisitos reglamentarios.




Si los usuarios envían una solicitud de no aprobación o eliminación de una medición, recibirán una notificación por correo electrónico en cuanto la solicitud haya sido aceptada o rechazada por un administrador del sistema.




VII.5 IMPORTAR LA INFORMACIÓN DEL PACIENTE DESDE UN ARCHIVO

La información del paciente correspondiente a un determinado QR-Code de prueba puede añadirse en un archivo .csv o .xls de importación de plantillas. Para descargar este archivo, vaya al área Tenant Admin y haga clic en "Manage Measurement Data Completion" en "Measurement data completion". Allí podrá elegir entre los formatos .csv y .xls (se sugiere xls).

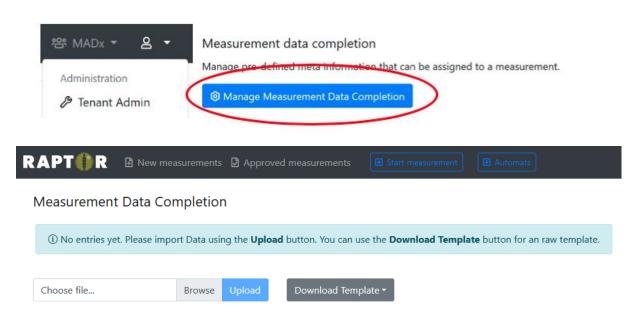

Una vez descargado el archivo de plantilla, puede introducir los datos específicos del paciente para el código QR o de muestra correspondiente, guardarlo en su ordenador, volver a cargar el documento y hacer clic en "Apply Changes". En el caso de las mediciones MAX, la correspondencia tendrá lugar basándose en el Código de muestra. Para las mediciones ImageXplorer, se proporcionará el código QR y se añadirá en la primera columna del archivo de plantilla. Para los dispositivos MAX, añada el Código de muestra en la primera columna y no añada un código QR.



Tras cargar este archivo, se mostrará la información introducida. Esta información se puede seguir editando y se pueden aplicar los cambios.








Si se adquiere una imagen y antes se ha cargado la información del código QR de la prueba correspondiente, la información del paciente se importa automáticamente en el software.

VII.6 AÑADIR UN USUARIO AL PORTAL DE COMPARTICIÓN DE RESULTADOS Y COMPARTIR UNA MEDICIÓN

Las mediciones pueden ser compartidas con un médico o un usuario que no esté registrado en ningún Tenant del RAPTOR SERVER. Para ello, primero debe crear una cuenta de usuario en el Portal de Compartición de Resultados para el médico. Para crear la cuenta, vaya a "Tenant Admin" →"Result Sharing Portal", haga clic en "Manage Users" y añada un nuevo médico.

Introduzca la información del usuario y envíe un correo electrónico para la creación de la contraseña. Alternativamente, puede predefinir la contraseña para el usuario. Asegúrese de cambiar el estado del usuario a "enabled".

Sólo pueden compartirse las mediciones ya aprobadas. Para ello, vaya a la pestaña "Approved Measurements", haga clic en la página de detalles de una medición, haga clic en el icono de menú y seleccione "View shares".

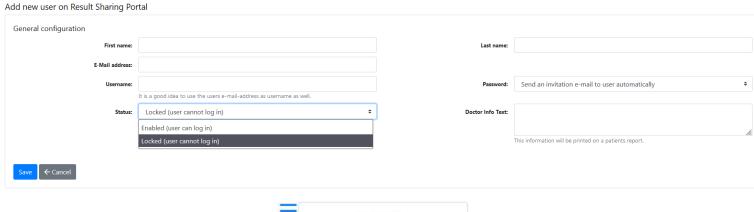






A continuación, seleccione el usuario con el que desea compartir la medición y haga clic en "Share". A continuación, puede enviar un enlace por correo electrónico para que el usuario pueda acceder a la medición.

Share

You are about to share a measurement with a user of the User Portal. Please note that the doctor will have access to the results of the measurement. Once you share a measurement you'll be provided with a link to access the shared information via the encrypted User F

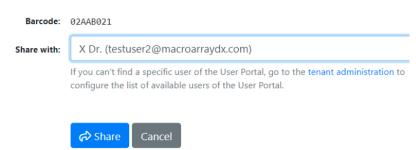


Las mediciones que se han compartido están marcadas con el siguiente símbolo en la lista



de mediciones aprobadas: Las medidas compartidas también pueden ser retiradas por un usuario arrendatario, haciendo clic en Revocar:

VII.7 CIERRE DE SESIÓN


Para salir de RAPTOR SERVER, haga clic en el símbolo del menú personal en la esquina superior derecha, elija "Log out" y cierre la ventana.






VII.8 PORTAL DE INTERCAMBIO DE RESULTADOS

Se puede acceder al Portal de intercambio de resultados a través de https://resultshare.raptor-server.com.

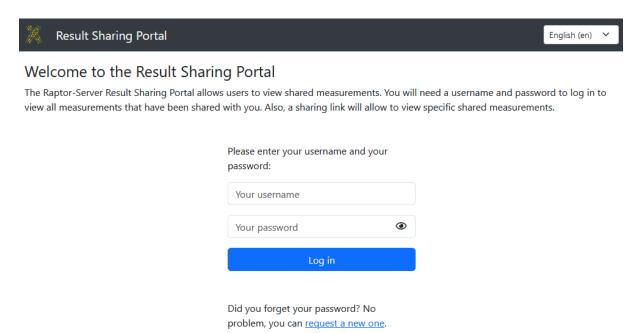


El idioma puede cambiarse en la parte superior de la pantalla. Haciendo clic en el icono del ojo se puede hacer visible la contraseña introducida. Se puede solicitar una nueva contraseña haciendo clic en "request a new one".

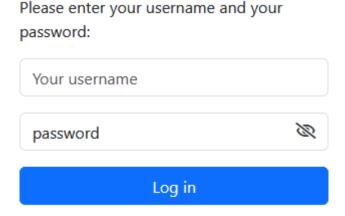

Tras iniciar sesión, el usuario puede ver los datos del paciente de las mediciones que se han compartido con él. En la parte superior de la página se puede cambiar la contraseña haciendo clic en "Change password".



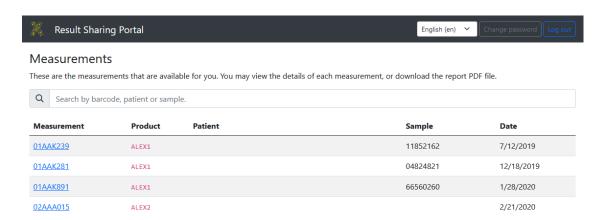


La lista de mediciones compartidas puede ordenarse por código QR, tipo de producto, nombre del producto, nombre del paciente, ID de la muestra o fecha.


Al hacer clic en el código QR de una medición, se abre una nueva página. En esta página se puede elegir individualmente el idioma del informe para cada medición.

Tras elegir el idioma, puede solicitarse una interpretación o descargar directamente el informe pulsando "Download Report". Al hacer clic en " Download Report" se abrirá una nueva ventana con el informe en formato pdf.

Measurement 02AYQ143

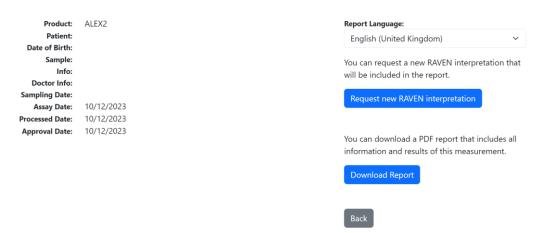

Salga del Portal de Compartición de Resultados pulsando el botón "Log out" situado en la parte superior de la pantalla.





VII.9 ASISTENCIA TÉCNICA

Si tiene alguna pregunta, experiencia o dificultad en relación con el RAPTOR SERVER Analysis Software, póngase en contacto con su distribuidor local.

VII.10 DATOS TÉCNICOS

Se puede acceder a la GUI de RAPTOR SERVER en un único navegador web. La aplicación está optimizada para Google Chrome en Windows 10 y 11. Los siguientes derechos de acceso deben estar habilitados para su uso, al menos en el puerto de salida 443:

- www.raptor-server.com
- api.raptor-server.com
- resultshare.raptor-server.com
- www.madx.com

VII.11 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los siguientes errores son los más comunes y, por tanto, se explican aquí con más detalle.

Error de conexión del servidor a www.raptor-server.com (el agente marca la conexión en rojo)



Posibles soluciones:

- Comprobar la conexión a Internet
- Haga clic en configuración y compruebe si RAPTOR SERVER URL (www.raptorserver.com) es correcto
- Haga clic en configuración y compruebe si la clave de ImageXplorer es correcta y se corresponde con la que especificado para el Arrendatario en RAPTOR SERVER






ImageXplorer Conexión fallida (El agente marca la conexión en color rojo):



Posibles soluciones:

- Compruebe si ImageXplorer está conectado al ordenador
- Vuelva a conectar ImageXplorer al ordenador (desenchufe y vuelva a enchufar el cable USB).
- Haga clic en configuración y compruebe si la clave de ImageXplorer es correcta y la misma que en RAPTOR SERVER

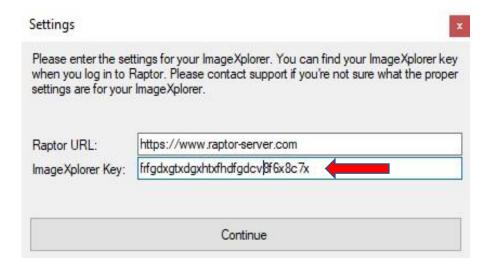



Inicio La medición no es posible:




Posibles soluciones:

- Compruebe si ImageXplorer está conectado
- Compruebe si se ha realizado la última exploración de ConfigXplorer necesaria.

Fallo en la transmisión de las mediciones al RAPTOR-SERVER:

Cada medición consta de 257 imágenes individuales (256 imágenes del ROI y 1 imagen del QR-code). Si el número de imágenes transferidas es inferior (debido a una transferencia inestable) aparece el mensaje de error ("Analysis Error: Insufficient data transfer – check connection" aparece con la imagen en el RAPTOR-SERVER. En este caso, hay que repetir la medición.



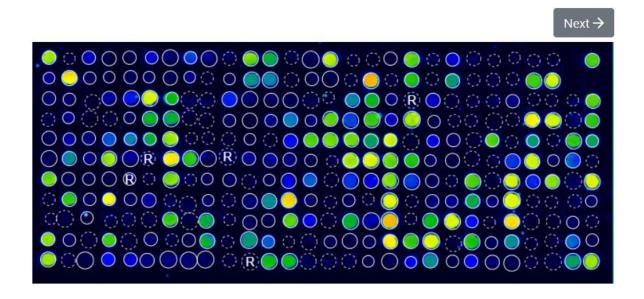

Received: 06.04.2023 13:37

ImageXplorer: 40287249

Analysis Error: Insufficient data transfer - check connection.

Posibles soluciones:

- Por favor, utilice el cable USB original, que fue enviado junto con el dispositivo.
- Utilice un puerto USB diferente en el ordenador al que está conectado ImageXplorer.
- La ImageXplorer debe conectarse a través de un puerto USB 3.0/3.1. Los ordenadores portátiles disponen de un puerto USB denominado "always-on" (normalmente el puerto situado junto al puerto de carga). Si es posible, utilice este puerto.
- Vuelva a conectar ImageXplorer al ordenador (desenchufe y vuelva a enchufar el cable USB).

Si sigue experimentando problemas o tiene alguna otra pregunta sobre los productos y servicios de MacroArray Diagnostics, póngase en contacto con su distribuidor local.



VIII. HISTORIAL DE CAMBIOS

Version	Descripción	Sustituye a
8.0	VII.1.3 Se ha añadido la posibilidad de aplicar la autenticación multifactorial (MFA), VII.3 Se ha añadido el lote 22670 de Lyphochek, y se han añadido el coreano, el kazajo y el chino (Hong Kong) como idiomas disponibles.	7.0

Software de análisis RAPTOR SERVER en combinación con los kits de ensayo ALEX², ALEX Air, ALEX Food y ALEX³:



Software de análisis RAPTOR SERVER en combinación con otros kits de pruebas MADx:



Derechos de autor de MacroArray Diagnostics

MacroArray Diagnostics (MADx)

Lemböckgasse 59, Top 4

1230 Vienna, Austria

+43 (0)1 865 2573

www.madx.com

Número de versión: 22-IFU-01-ES-08 (EN-25)

Fecha de emisión: 2025-11